

19 NOV. 2004

adottata da Direttore Generale in data _____

Oggetto: *Publico incanto - procedura aperta - per la fornitura e installazione "chiavi in mano" di apparecchiature per le Sedi di Continuita' Assistenziale, Pediatria e Pneumologia PO F.Ili Crobu, Traumatologia CTO e Servizi diversi, compreso contratto di manutenzione assicurativa quinquennale*
Ratifica atti di gara. Aggiudicazione in favore Ditte diverse.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Vista la Delibera n° 916 del 21.04.2004, con la quale l'Azienda ha indetto il pubblico incanto PER la fornitura di apparecchiature per le Sedi di Continuita' Assistenziale, Pediatria e Pneumologia PO F.Ili Crobu, Traumatologia CTO e Servizi diversi, compreso contratto di manutenzione assicurativa quinquennale, approvando contestualmente il Capitolato di gara;

Atteso che in applicazione del D.Lgs 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, è stata disposta la pubblicazione del bando di gara sulla GURI Parte Seconda n° 109 del 11.05.2004 e sulla GU.CEE e per estratto sui quotidiani Il Sole 24 Ore, La Nuova Sardegna e Gazzetta Aste e Appalti pubblici;

Visti i verbali di gara in data 30.06.2004 – 13.07.2004 - 19.07.2004 – 21.09.2004 e 27.09.2004 della Commissione di aggiudicazione, nominata con Disposizione Amministrativa n° 58/2004 del 03.06.2004, rettificata con Disposizione Amministrativa n° 70/2004 del 09.06.2004 e successiva n° 75/2004 del 25.06.2004;

Preso atto che la Commissione ha proposto l'aggiudicazione in favore di Ditte Diverse, ai sensi dell'art. 19 punto 1 b del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, dichiarando deserti i lotti: 4 e 5;

Visti il Capitolato Speciale e il Capitolato Generale;

Visto il D.Lgs 358/92, così come modificato dal D.Lgs 402/98;

Ravvisata la legittimità delle operazioni svolte in sede di pubblicazione e in sede di gara;

Propone

- di disporre l'aggiudicazione della gara a pubblico incanto per la fornitura di *apparecchiature per le Sedi di Continuita' Assistenziale, Pediatria e Pneumologia PO F.Ili Crobu, Traumatologia CTO e Servizi diversi, compreso contratto di manutenzione assicurativa quinquennale*, così come si evince dai verbali della Commissione di aggiudicazione, allegati al presente atto, per costituirne parte integrante;
- di indire nuova gara a mezzo trattativa privata plurima per i Lotti dichiarati deserti, ai sensi dell'art. 9 punto 6 lett. a) del D.Lgs 358/92;

Il Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;


Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di ratificare gli allegati verbali in data 30.06.2004 – 13.07.2004 - 19.07.2004 - 21.09.2004 e 27.09.2004 della Commissione di aggiudicazione del pubblico incanto per la fornitura di *apparecchiature per le Sedi di Continuita' Assistenziale, Pediatria e Pneumologia PO F.Ili Crobu, Traumatologia CTO e Servizi diversi, compreso contratto di manutenzione assicurativa quinquennale*, indetto con Delibera 916/2004;
- ▶ di disporre l'aggiudicazione così come riportato nel prospetto allegato, costituito da n° 5 pagine e parte integrante della presente delibera;
- ▶ di dichiarare deserti i **Lotti: 4 e 5**;
- ▶ di autorizzare il ricorso alla trattativa privata ad offerte plurime per i lotti 4 e 5 dichiarati deserti, ai sensi dell'art. 9 punto 6 lett. a) del D. Lgs 358/92;
- ▶ di dare atto che gli affidamenti in favore delle sottoelencate Ditte sono soggetti a stipula contrattuale:
 - Sanifarm
 - Terapon
 - Voden Medical Instruments
 - Elettromedical
 - Technos;
- ▶ di disporre l'affidamento provvisorio delle sopraindicate Ditte nelle more di predisposizione del relativo contratto di fornitura;
- ▶ di dare atto che l'affidamento provvisorio decorre dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, e che tale decorrenza deve essere dichiarata in sede di stipula contrattuale quale validità del contratto medesimo;
- ▶ di dare atto che gli affidamenti in favore delle sottotelencate Ditte, si intendono operativi con decorrenza dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, in quanto non soggetti a stipula contrattuale:
 - PS Medical
 - Prodifarm
 - Axosan Gross;
- ▶ di rinviare a successivo ed apposito atto l'eventuale affidamento relativo al contratto quinquennale del servizio di manutenzione full-risk post garanzia;
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura, nonché per quelli correlati all'espletamento della trattativa privata plurima per l'affidamento dei lotti dichiarati deserti;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di imputare la spesa complessiva di **€ 358.865,28** IVA 20% inclusa sulle classi di costo 020300004 e 020400001 del piano dei conti aziendale sulle apposite finalizzazioni dei PP.II. e nello specifico:
 - € **29.512,88** sulle apposite finalizzazioni del PI 2002, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 2362 del 10.11.2003 e precisamente:
 - € 8.675,28 sulla finalizzazione di € 10.000,00 per l'acquisto di apparecchiature per la Pediatria del PO F.Ili Crobu (Lotto 6)
 - € 20.000,00 sulla finalizzazione di € 20.000,00 per l'acquisto di attrezzature per la Traumatologia del PO CTO (Lotto 9)





Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. N. 7
Carbonia

segue Deliberazione **2560** del **19 NOV. 2004**


- € 837,60 sulla finalizzazione di € 11.706,96 per l'acquisto di apparecchiature per il Pronto Soccorso del PO Sirai (Lotto 11)
- € 129.822,62** sulle apposite finalizzazioni del PI 2003 Stralcio, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 1939 del 24.09.2003 e precisamente:
- € 49.238,51 sulla finalizzazione di € 145.456,90 per l'acquisto di apparecchiature (Lotto 1)
- € 4.224,00 sulla finalizzazione di € 140.000,00 per l'acquisto di attrezzature per gli ambulatori (Lotto 3)
- € 76.360,11 sulla finalizzazione di pari importo di cui alla Delibera di variazione n° 2323 del 27.10.2004 (Lotto 1 e Lotto 2)
- € 199.529,78** sulle apposite finalizzazioni del PI 2003, così come da Delibera di variazione n° 2322 del 27.10.2004, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 646 del 20.04.2004, e precisamente:
- € 67.623,10 sulla finalizzazione di € 90.000,00 per i maggiori oneri acquisto apparecchiature per le Sedi di Continuità Assistenziale (Lotto 2);
- € 46.082,40 sulla finalizzazione di € 46.082,40 per l'acquisto di apparecchiature per servizi diversi (Lotto 2 e Lotto 10)
- € 37.122,72 sulla finalizzazione di € 37.122,72 per i maggiori oneri acquisto apparecchiature per la Pediatria del PO F.lli Crobu (Lotto 6 e Lotto 7)
- € 37.877,56 sulla finalizzazione di € 37.877,56 per la Traumatologia del CTO (Lotto 9)
- € 10.824,00 sulla finalizzazione di € 10.824,00 per la Pneumologia del F.lli Crobu (Lotto 8)

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato speciale di gara, le Ditte Sanifarm e Terapon hanno proposto in sede di offerta uno sconto condizionato, rispettivamente del 3% e 0,95% per le seguenti condizioni favorevoli di pagamento da parte dell' Azienda:
- liquidazione dell' 80% dell'importo della sola fornitura entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura stessa, purché l'invio della fattura sia successivo alla consegna della merce ordinata, previa verifica di rispondenza all'offerta ed al Capitolato e sua accettazione;
 - liquidazione del 10% entro trenta giorni dal collaudo positivo;
 - liquidazione del 10% a saldo entro trenta giorni dalla data di attestazione del Reparto utilizzatore di avvenuto avviamento ed istruzione del personale;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 del Capitolato speciale di gara, gli affidamenti oggetto del presente atto hanno validità di un anno dalla data di stipula contrattuale, pertanto nel corso dell'anno di validità l'Azienda si riserva di procedere, mediante adozione di appositi atti, ad ulteriori acquisti alle medesime condizioni e prezzi, per un importo non superiore all'importo contrattuale;

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/AGULLI
ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

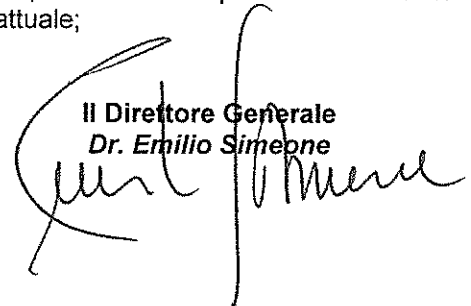

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2560 del 19 NOV. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 23 NOV. 2004 al 7 DIC. 2004


Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(*Dr.ssa Margherita Cannas*)



Allegati n°

Destinatari:

Bilancio

Revisori

Acquisti

Resp.le Pneumologia F.Ili Crobu

Resp.le Pediatria F.Ili Crobu

Resp.le Traumatologia CTO

Resp.le Sanitario Distretto Carbonia

Resp.le Sanitario Distretto Iglesias

Prospetto aggiudicazione

Ditta Sanifarm	Prezzi unitari	Quantità	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
offerta n° 04/06-2004 del 25.06.2004					
Lotto 1					
Sterilizzatrice marca TECNO_GAZ mod. VACUUM xp cod. 2052S	€ 2.600,00	22	€ 57.200,00	€ 11.440,00	€ 68.640,00
Percentuale di sconto per condizioni di pagamento migliorative, ai sensi dell'Art. 17 del Capitolato Speciale	3%				
Ditta Terapon					
offerta n° 182/04/MP/1m del 22.06.2004					
Lotto 2					
Defibrillatore semiautomatico mod. Heartstart HS1 Laerdal	€ 1.759,00	25	€ 43.975,00	€ 8.795,00	€ 52.770,00
Carrello per defibrillatore HS1	€ 190,00	3	€ 570,00	€ 114,00	€ 684,00
Elettrocardiografo mod. PageWrite TRIM I cod. 860290 Philips	€ 1.725,00	35	€ 60.375,00	€ 12.075,00	€ 72.450,00
Carrello per elettrocardiografo PageWrite	€ 190,00	13	€ 2.470,00	€ 494,00	€ 2.964,00
Elettrocardiografo mod. PageWrite TRIM II cod. 860288 Philips	€ 2.850,00	1	€ 2.850,00	€ 570,00	€ 3.420,00
Carrello per elettrocardiografo PageWrite	€ 190,00	1	€ 190,00	€ 38,00	€ 228,00
Carrello per emergenza mod. Armstrong cod. ABL243110 VIVIAM	€ 1.235,00	22	€ 27.170,00	€ 5.434,00	€ 32.604,00
				Totale lotto 22	€ 165.120,00
Percentuale di sconto per condizioni di pagamento migliorative, ai sensi dell'Art. 17 del Capitolato Speciale	0,95%				

Ditta Axosan Gross offerta del 24.06.2004	Prezzi unitari	Quantità	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
Lotto 3					
Negativoscopia da parete GIVAS art. AN6008 dim 93x13x48h	€ 160,00	22	€ 3.520,00	€ 704,00	€ 4.224,00
			Totale lotto 26	€	4.224,00
Ditta Voden Medical Instruments s.r.l. offerta del 18.06.2004	Prezzi unitari	Quantità	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
Lotto 6					
Apparecchio per micrometodi composto da: Strumento per l'analisi dei PO2, PCO2, pH ed elettroliti OPTI CCA cod. GDT045	€ 9.180,00	1	€ 9.180,00	€ 1.836,00	€ 11.016,00
Analizzatore ematologico mod. Micros 60CT	€ 11.656,00	1	€ 11.565,00	€ 2.313,00	€ 13.878,00
			Totale lotto 29	€	24.894,00

Prospetto aggiudicazione

Ditta Elettromedical	Prezzi unitari	Quantità	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
offerta n° 252/2004 AM/CA/ac del 23.06.2004					
Lotto 7					
Laboratorio spirometrico computerizzato COSMED mod. QUARK PFT2 completo di accessori - Cod. C09032-01-99. Completo di:		1			
Manometro CAL mix per bombola EDCGA-973 cod. A870150005		1			
Manometro 100% O2 per bombola di ossigeno cod. A870150006		1			
Bombola gas, OXIGEN 99,99% CGA-870 cod. A860000007	€ 17.420,00	1	€ 17.420,00	€ 3.484,00	€ 20.904,00
Bombola gas calibration mix (16% O2, 5% CO2, N2 resto) CGA973 cod. A860000004		1			
Personal computer dedicato, di ultima generazione completo di monitor 17", masterizzatore, tastiera, mouse, stampante a colori ad alta definizione, Windows - cod. HARDW.SUPP		1			
Lotto 8					
Polissonnografo COSMED mod. SOMNOSCREEN RC (Respiratory) cod.A661700001	€ 8.160,00	1	€ 8.160,00	€ 1.632,00	€ 9.792,00
Somnoscreen sensore di movimento per PLM (3 assi) cod. A661970013	€ 430,00	2	€ 860,00	€ 172,00	€ 1.032,00
			Totale lotto 8	€ 10.824,00	€ 31.728,00
			Totale fornitura	€	€ 31.728,00

Ditta Technos	Prezzi unitari	Quantità	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
offerta n° 325/04 del 18.06.2004					
Lotto 9					
Sistema motorizzato elettrico così composto:					
Centralina di controllo F.ADVANTAG-ART. D30001	€ 2.346,50	1	€ 2.346,50	€ 469,30	€ 2.815,80
Cavo connessione CENTR.-MANIP. Power PRO E9000 ADVANTAGE - ART. MC5057	€ 1.446,20	1	€ 1.446,20	€ 289,24	€ 1.735,44
Manipolo POWER PRO ELETTR. MOD. II SERIE ART. PRO6100	€ 6.090,00	1	€ 6.090,00	€ 1.218,00	€ 7.308,00
Attacco POWER PRO tipo Zimmer/Hudson ART. PRO2046	€ 1.066,80	1	€ 1.066,80	€ 213,36	€ 1.280,16
Attacco POWER PRO II alesatore 5:1 tipo Zimmer/Hudson ART. PRO6047	€ 1.428,00	1	€ 1.428,00	€ 285,60	€ 1.713,60
Attacco POWER PRO II Mandrino di JACOBS 1/4" ad alta coppia ART. PRO6042	€ 1.428,00	1	€ 1.428,00	€ 285,60	€ 1.713,60
Attacco POWER PRO Mandr. 1/4", con serr. senza chiave ART. PRO2250	€ 1.718,50	1	€ 1.718,50	€ 343,70	€ 2.062,20
Attacco POWER PRO sega reciproca ART. PRO2045	€ 2.635,50	1	€ 2.635,50	€ 527,10	€ 3.162,60
Sega oscillante PROWER PRO II serie - ART. PRO6125	€ 6.195,00	1	€ 6.195,00	€ 1.239,00	€ 7.434,00
Manipolo POWER PRO ELETTR. MOD. II SERIE ART. PRO6100	€ 6.090,00	1	€ 6.090,00	€ 1.218,00	€ 7.308,00
Attacco POWER PRO II Spara fili con cannulaz. Da 2 a 3,2 mm ART. PRO6032	€ 1.608,60	1	€ 1.608,60	€ 321,72	€ 1.930,32
Attacco POWER PRO II Spara fili con cannulaz. Da 0,7 a 1,6 mm ART. PRO6028	€ 1.428,00	1	€ 1.428,00	€ 285,60	€ 1.713,60
Trapano media velocità - ART. 5020.021.00	€ 2.888,20	1	€ 2.888,20	€ 577,64	€ 3.465,84
Sega oscillante - ART. 5020.024.00	€ 3.069,50	1	€ 3.069,50	€ 613,90	€ 3.683,40
Sega reciproca - ART. 5020.023.00	€ 3.069,50	1	€ 3.069,50	€ 613,90	€ 3.683,40
Sega sagittale - ART. 5020.022.00	€ 3.069,50	1	€ 3.069,50	€ 613,90	€ 3.683,40
Manipolo ad alta velocità ADVANTAGE - ART. D9820	€ 2.031,50	1	€ 2.031,50	€ 406,30	€ 2.437,80
Controllo multifunzione a 3 pedali per POWER PRO/E9000/ADVANTAGE ART. C9863	€ 622,00	1	€ 622,00	€ 124,40	€ 746,40
				Totale fornitura	€ 57.877,56

Ditta PS Medical offerta del 23.06.2004	Prezzi unitari	Quantità	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
Lotto 10					
Aspiratore chirurgico su ruote GIMA mod. TOBI CLINIC cod. 28215	€ 660,00	7	€ 4.620,00	€ 924,00	€ 5.544,00
Ditta Prodifarm offerta n° 399/mgt del 22.06.2004	Prezzi unitari	Quantità	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
Lotto 11					
Aspiratore chirurgico con vaso riutilizzabile da 1000 ml, a alimentazione elettrica e batterie ricaricabili mod. VENTA CC26 orig. MEDAP	€ 698,00	1	€ 698,00	€ 139,60	€ 837,60

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°7


CARBONIA (CA)

Oggetto: Verbale della Commissione di aggiudicazione pubblico incanto per la fornitura ed installazione "Chiavi in mano" di apparecchiature e attrezzature per le ~~Sedi di apparecchiature~~ Sedi di Continuità Assistenziale - Pediatria e Pneumologia PO F.lli Crobu - Traumatologia PO CTO - Servizi Diversi, compreso contratto di manutenzione assicurativa quinquennale

Addì 30 del mese di giugno dell'anno 2004 alle ore 10,45, nella sede della USL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in pubblica, previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione individuata con Disposizione Amministrativa n° 58/2004 del 03.06.2004, rettificata con Disposizione Amministrativa n° 70/2004 del 09.06.2004 e successiva n° 75/2004 del 25.06.2004 presieduta dal Geom. Gerolamo Agulli e composta come segue:

Dr. Marco Sulcis

Componente



Dr. Marco Grussu

Componente

Dr. Rinaldo Aste

Componente

Dr. Pietro Greco

Componente



Dr. Sergio Perisi

Componente


Dr. Piero Caddeo

Componente




Sig.ra Alessandra Ventura

Segretario

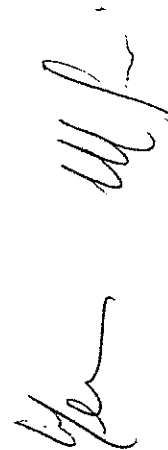

Premesso:

- Che l'appalto è stato indetto con Delibera n° 916 del 21.04.2004, approvando

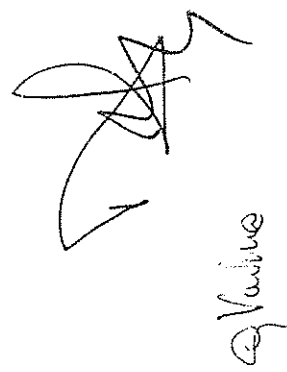








contestualmente in Capitolato Speciale di gara;

- Che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n° 109 del 11.05.2004 e sulla GUCEE e per estratto sui quotidiani "La Nuova Sardegna" e "Il Sole 24" in data 08.05.2004, sulla "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" in data 07.05.2004 e sulla "Gazzetta del Sulcis".
- Che il bando di gara stabilisce il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del giorno 28.06.2004, e l'esperimento pubblico d'appalto in data odierna:
- Che entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle seguenti Ditte:

Instrumentation Laboratoy	Prot. 12167	del 21.06.2004
Esaoite	Prot. 12363	del 23.06.2004
Sensor Medics Italia	Prot. 12481	del 24.06.2004
Vivisol	Prot. 12489	del 24.06.2004
Sapio Life	Prot. 12531	del 24.06.2004
Terapon	Prot. 12593	del 25.06.2004
Stryker Italia	Prot. 12595	del 25.06.2004
Voden Medical Instruments	Prot. 12596	del 25.06.2004
S.D.T. Sistemi e Tecnologie Dentali	Prot. 12597	del 25.06.2004
GE Medical Systems Information Technologies	Prot. 12662	del 25.06.2004
Linde Gas Italia	Prot. 12663	del 25.06.2004
Technos	Prot. 12665	del 28.06.2004
Prodifarm	Prot. 12668	del 28.06.2004
Elettromedical	Prot. 12670	del 28.06.2004
Sanifarm	Prot. 12675	del 28.06.2004
PS Medical	Prot. 12676	del 28.06.2004

Medine

Medical Graphics Italia	Prot. 12674	del 28.06.2004
Euromed Sardegna	Prot. 12680	del 28.06.2004
Medical	Prot. 12689	del 28.06.2004
Nuova Sarda Medicali	Prot. 12699	del 28.06.2004
Axosan Gross	Prot. 12715	del 28.06.2004
Air Liquide Service	Prot. 12718	del 28.06.2004
A. De Mori	Prot. 12719	del 28.06.2004
Formesa	Prot. 12720	del 28.06.2004
Modesto Manca	Prot. 12723	del 28.06.2004
Sirio Medical	Prot. 12724	del 28.06.2004
Anamed	Prot. 12747	del 28.06.2004

Tutto ciò premesso il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sono i presenti i Sigg.

Alessandro Marcias per la Ditta Elettromedical, Stefano Mereu per la Ditta GE Medical Systems Information Technologies e per la Ditta Medical Graphics, Marco Marras per la ditta Euromed, Giancarlo Piras per la Ditta Linde Gas Italia, Riccardo Cherri per la Ditta Anamed e Ditta Systems Information Technologies, Mario Lai per la Ditta Voden Medical Instruments, Lorenzo Canu per la Ditta Medical, Paolo Paderi per la Ditta Technos, Arturo De Sotgiu per la Ditta Modesto Manca, Mauro Cocco per la Ditta Esaote, Massimo Fenu per la Ditta Prodifarm.

La Commissione procede al controllo della regolarità formale nella presentazione dei plichi. I plichi sono regolari fatta eccezione di quello della ditta Sensor Medics Italia; il plico è pervenuto completamente lacerato e aperto, così come da attestazione del Servizio Protocollo Aziendale, apposta il calce al plico medesimo.

Pertanto la Commissione, al fine di garantire la massima trasparenza degli atti,





ritiene doveroso escludere la Ditta Sensor Medics Italia dalle fasi successive di gara.

La Commissione procede al controllo della documentazione prodotta dalle restanti

Ditte:

Ditta Instrumentation Laboratory, conforme, si ammette. Offre il lotto 6.

Ditta Esaote, conforme, si ammette. Offre il lotto 2.

Ditta Vivisol, conforme, si ammette. Offre il lotto 8.

Ditta Sapio life, conforme, si ammette. Offre il lotto 8.

Ditta Terapon, conforme, si ammette. Offre i lotti: 2 – 3.

Ditta Stryker Italia, conforme, si ammette. Offre il lotto 9.

Ditta Voden Medical Instruments, conforme, si ammette. Offre il lotto 6

Ditta S.D.T. Sistemi e Tecnologie Dentali, conforme, si ammette. Offre i lotti: 1- 5.

Ditta GE Medical Systems Information Technologies, conforme, si ammette. Offre il lotto 2.

Ditta Linde Gas Italia, conforme, si ammette. Offre il lotto 8.

Ditta Technos, conforme, si ammette. Offre i lotti: 1 – 4 – 9 – 11.

Ditta Prodifarm, conforme, si ammette. Offre i lotti: 2 – 4 – 10 – 11.

Ditta Elettromedical, conforme, si ammette. Offre i lotti: 1 – 2 - 3 - 4 – 7 - 8

Ditta Nuova Sarda Medicali, conforme, si ammette. Offre i lotti: 1 – 2 – 10- 11

Ditta Axosan Gross, conforme, si ammette. Offre i lotti: 1 – 2 – 3

Ditta Air Liquide Service, conforme, si ammette. Offre il lotto 10.

Ditta A. De Mori , conforme, si ammette. Offre il lotto 6.

Ditta Formesa, conforme, si ammette. Offre i lotti. 1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 10 - 11

Ditta Modesto Manca, conforme, si ammette. Offre i lotti: 2 – 3

Ditta Sirio Medical, conforme, si ammette. Offre i lotti: 1 – 3 – 4 – 10 - 11

Q. Verluc

Luigi Sergio Perini

ufo.

Daddis

Ditta Euromed Sardegna, conforme, si ammette. Offre i lotti: 1 – 2.

Ditta Anamed, conforme, si ammette. Offre i lotti: 1 – 3 – 8.

Ditta Sanifarm, conforme, si ammette. Offre i lotti: 1 – 2 – 3 – 4 - 10

Ditta PS Medical, conforme, si ammette. Offre i lotti: 1 – 3 – 4 – 10 - 11

Ditta Medical Graphics Italia, la documentazione presentata è carente della cauzione provvisoria richiesta al punto 1 dell'art. 6 del Capitolato Speciale di gara.

La Ditta viene esclusa.

Ditta Medical, conforme, si ammette. Offre i lotti: 1 – 2 – 3 – 5


La Commissione procederà in seduta privata alla valutazione tecnico-qualitativa dei singoli apparecchi offerti e all'attribuzione del relativo punteggio.

Le buste contenenti le offerte economiche vengono inserite in una più grande che viene sigillata e controfirmata dal Presidente, dalla Commissione e dai testi.


Alle ore 12,15 il Presidente aggiorna la seduta in data da destinarsi.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

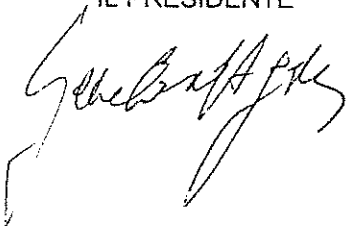



LA COMMISSIONE

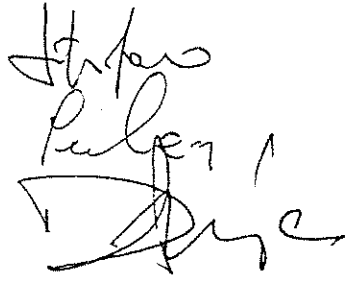

IL SEGRETARIO



I TESTI

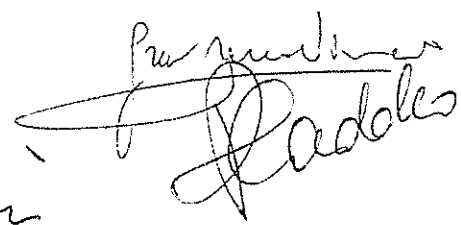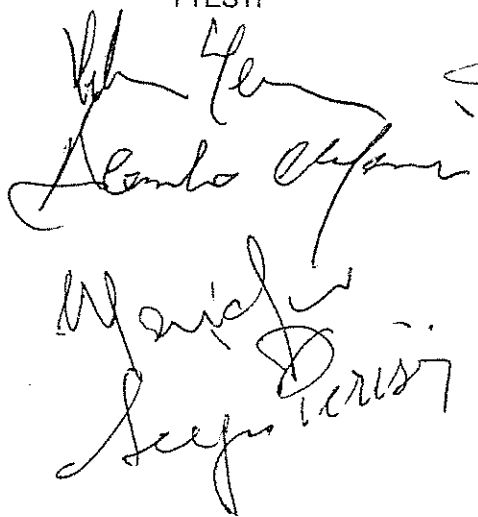

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°7


CARBONIA (CA)

Oggetto: *Verbale della Commissione di aggiudicazione pubblico incanto per la fornitura ed installazione "Chiavi in mano" di apparecchiature e attrezzature per le Sedi di Continuità Assistenziale – Pediatria e Pneumologia PO F.lli Crobu – Traumatologia PO CTO – Servizi Diversi, compreso contratto di manutenzione assicurativa quinquennale.*

Addì 13 del mese di luglio dell'anno 2004 alle ore 10,00, nella sede della USL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata la commissione di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, presieduta dal Geom. Gerolamo Agulli e composta dal Dr. Marco Sulcis, dal Dr. Marco Grussu, dal Dr. Sergio Perisi, dal Dr. Pietro Greco, dal Dr. Rinaldo Aste, dal Dr. Piero Caddeo e dalla Sig.ra Alessandra Ventura con funzioni di segretario, per la stesura definitiva del verbale dei lavori di valutazione tecnico qualitativa dei singoli prodotti offerti e all'attribuzione del relativo punteggio ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale, a seguito della precedente seduta privata di valutazione tenutasi in data 06.07.2004 e 12.07.2004.

La Commissione ha proceduto all'esame delle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti offerti tenendo conto e confrontando la tecnologia e qualità costruttiva, la struttura portante, il carattere estetico e funzionale, nonché valutando le migliori rispetto alle caratteristiche indicate per ciascun prodotto.

Dopo attenta analisi, la commissione è pervenuta alle conclusioni risultanti dal prospetto comparativo allegato, costituito da n° 15 pagine e parte integrante del

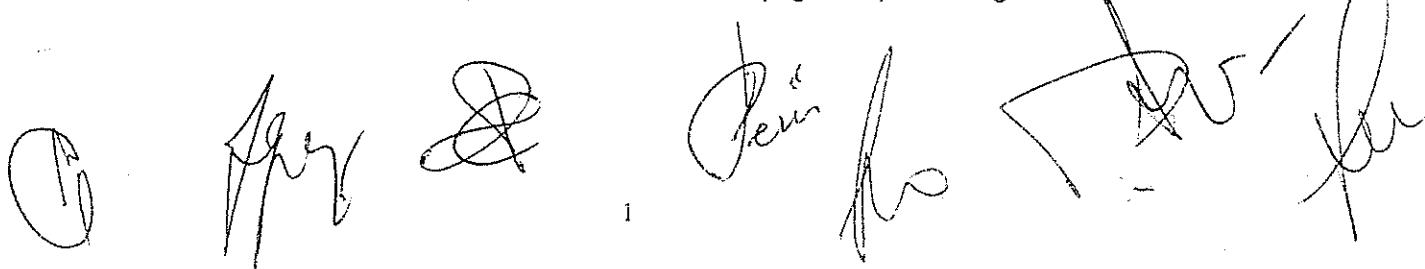A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or names like 'Perisi' and 'Aste'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.

presente verbale. Nel prospetto sono stati indicati per ciascun lotto le ditte offerenti, i modelli di apparecchiature proposti, la valutazione della commissione, nonché i punteggi qualità attribuiti sulla base dei parametri individuati all'art. 10 punto B del Capitolato Speciale e nello specifico:

B1 *Maggiore completezza della dotazione e qualità costruttiva, e di composizione dell'apparecchiatura offerta legata ad una completezza (maggior e miglior dotazione) degli apparecchi e degli accessori d'uso valutando le migliori rispetto alle caratteristiche base del presente Capitolato. Si terrà conto anche dell'anno di prima immissione in commercio* **23/60**

B2 *migliore soluzione tecnologica miglior funzionalità, maneggevolezza, migliori soluzioni di installazione e d'uso* **27/60**

B3 *miglior organizzazione aziendale e certificazione di qualità* **3/60**

B4 *miglior piano programmatico per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature* **4/60**

B5 *Certificazione Serie UNI EN ISO 90001:2000 delle Ditte manutentrici* **3/60**

Nell'esame di valutazione di qualità del coefficiente di valutazione identificato nel Capitolato Speciale come B4 la commissione ha attribuito un punteggio che tiene conto delle caratteristiche di disponibilità, frequenza e completezza degli interventi in rapporto alle caratteristiche dell'apparecchio.



Del presente verbale si darà lettura nella seduta pubblica della Commissione fissata per le ore 10,00 del giorno 19.07.2004.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE



LA COMMISSIONE

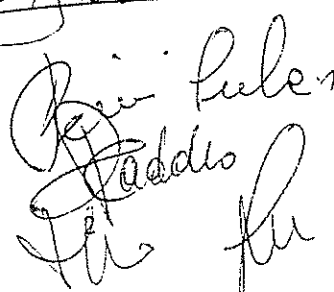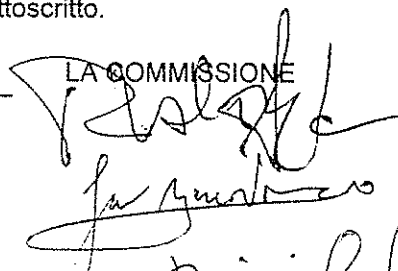


IL SEGRETARIO




Prospetto comparativo prodotti


Lotto 1	n° 22 sterilizzatrici	Modello	Valutazione	B1 - punti 23/60 (migliore e migliore dotazione e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9001: 2000 vision = 3 punti))	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Dille manufatturici)	Totale punti
Anamed	S ANDROMEDA VACUUM XP TECNO-GAZ COD. 2052-S	Stampante integrata. Volume 16lt. Conforme	18	20	1	2,5	0	41,5	
Axosan Gross	AMS GALENO MOD. EGLE ART.402	Stampante non integrata. Volume 15 lt. Conforme	18	15	1	3	0	37	
Elettromedical	ANDROMEDA VACUUM cod. 36651	Stampante integrata. Conforme	18	20	3	2,5	3	46,5	
Euromed Sardegna	LIARRE mod. STARCLAVE NEW PRINT Art. 159	Stampante integrata. Conforme	18	20	1	1,5	0	40,5	
Formosa	ANDROMEDA PLUS XP	Stampante non integrata. Non specifica il volume. Conforme	18	15	1	1,5	3	38,5	
Formosa - Alternativa	ANDROMEDA VACUUM XP	Stampante non integrata. Non specifica il volume. Conforme	18	15	3	1,5	3	40,5	
Medical	ANDROMEDA VACUUM XP cod. 2052-S	Stampante integrata. Volume 16lt. Conforme	18	20	3	1,5	3	45,5	
Nuova Sarda Medicali	ANDROMEDA VACUUM XP cod. 2052-S	Stampante integrata. Volume 16lt. Conforme	18	20	3	2,5	3	46,5	
PS Medical	Galeno mod. EGLE cod. 402 + stampante mod. 403/1	Stampante non integrata. Volume 15 lt. Conforme	18	15	1	3	0	37	
S.D.T. Sistemi e Tecnologie Dentali	Sirona SIROCLAVE B + Stampante SEIKO DPU 414	Stampante non integrata. Volume 18 lt. Conforme	18	15	3	2,5	0	38,5	
Sanifarm	TECNO-GAZ mod. VACUUM XP COD. 2052-S	Stampante integrata. Volume 16lt. Conforme	18	20	1	4	3	48	
Sirio Medical	Stericlave 18S Dynamica cod. STERIL 18SEPRINT	Volume 18 lt. Non specifica se la stampante è integrata o meno. Conforme	18	20	1	2,5	0	41,5	
Technos	DELTA RT45 cistampante art. AMT45S	Stampante non integrata. Non specifica il volume. Conforme	18	15	1		0	34	



 1







Prospetto comparativo prodotti

Lotto 2	Modello	Valutazione	B1- punti 23/60 (maggiore e migliore dotazione e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9001: 2000 vision = 3 punti))	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Ditte manifatturiere)	Totale punti
n° 25 Defibrillatori (di cui 3 con carrello) - n° 36 Elettrocardiografi (di cui 13 con carrello) - n° 1 Elettrocardiografo con carrello - n° 22 carrelli per emergenza	Defibrillatore MOD. REANIBEX - 200; Carrello mod. Ar-PAM	Conforme. Buona la qualità costruttiva e sufficiente funzionalità.	19,5	18,25	1	4	0	42,75
Axosan Gross	Elettrocardiografo CARDIOLINE MOD. DELTA 60 PLUS; Carrello mod. G.PAM - Elettrocardiografo CARDIOLINE MOD. ELAN UP completo di monitor Delta VIS + Carrello mod. G.PAM - Carrello per emergenza GALENO mod. LUXOR Art. MS21							
Elettromedical	Defibrillatore MOD. LIFELINE AED DEFIBTECH di cui tre c/carrello - Elettrocardiografo CARDIETTE MOD. ar 2100 view di cui 13 c/carrello - Elettrocardiografo CARDIETTE MOD. ar 2100 view c/carrello - Carrello per emergenza GIVAS cod. CP0020 SATURNO + Cod. CP0020 + CP079	Conforme. Buona la qualità costruttiva e sufficiente funzionalità.	20,75	21,75	3	3	3	51,5
Elettromedical - Alternativa	Defibrillatore MOD. LIFELINE AED DEFIBTECH di cui tre c/carrello - Elettrocardiografo Mortara Rangoni mod. ELI 210 di cui 13 c/carrello - Elettrocardiografo CARDIETTE MOD. ar 2100 view c/carrello - Carrello per emergenza GIVAS cod. CP0020 SATURNO + Cod. CP0020 + CP079	Conforme. Buona la qualità costruttiva e la funzionalità.	21,5	22,5	3	3	3	53



 fu D₁ 2

Prospetto comparativo prodotti


Lotto 2	n° 25 Defibrillatori (di cui 3 con carrello) - n° 35 Elettrocardiografi (di cui 13 con carrello) - n° 1 Elettrocardiografo con carrello - n° 22 carrelli per emergenza	Modello	Valutazione	B1 - punti 23/60 (migliore e migliore dotazione o qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9001:2000 vision = 3 punti)	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Dille manufatturici)	Totale punti
Esaote	Defibrillatore SCHILLER MOD. FRED easy di cui tre c/carrello Elettrocardiografo ESAOTE mod. P 8000 POWER BASE di cui 13 c/carrello Elettrocardiografo ESAOTE mod. P 8000 POWER BASE c/carrello Carrello per emergenza METRO mod. LIFELINE LEC 53	Confermi. Buona la qualità costruttiva e la funzionalità.	20	22,5	3	2	3	50,5	
Euromed Sardegna	Defibrillatore MOD. LIFEPAK LP 500 BIFASICO Cod. 99401, di cui tre c/carrello cod. 27428 Elettrocardiografo mod. CARDIOTOUCH 3000S di cui 13 c/carrello cod. 27428 Elettrocardiografo mod. CARDIOTOUCH 3000S c/carrello cod. 27428 Carrello per emergenza mod. MASTER cod. A-ABL243110	Conferme. Buona la qualità costruttiva e la funzionalità.	20,75	22	1	2	0	45,75	
Formosa	Defibrillatore Welch Alllyn Mod. AED 10, di cui tre c/carrello Galeno cod. CAR2P60B+AC400 Elettrocardiografo GIMA cod. 33355+33357 di cui 13 c/carrello Galeno cod. CAR2P60B+AC400 Elettrocardiografo GIMA cod. 33355+33357 c/carrello Galeno cod. CAR2P60B+AC400 Carrello per emergenza EXPER cod. PCL+SG	Escluso. La documentazione è carente della scheda tecnica e dei depliant relativo al carrello per emergenza offerto.	Escluso						

Luca 3




Prospetto comparativo prodotti

Lotto 2	n° 25 Defibrillatori (di cui 3 con carrello) - n° 36 Elettrocardiografi (di cui 13 con carrello) - n° 1 Elettrocardiografo con carrello - n° 22 carrelli per emergenza	Modello	Valutazione	B1 - punti 23/60 (migliore dotazione e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9001:2000 vision = 3 punti))	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Ditte manifatturiere)	Totale punti	
Ditta	GE Medical Technologies Systems Information	Defibrillatore mod. RESPONDER AED, di cui tre c/carrello cod. SPECIALS	<p>Conformi. Discreta la qualità costruttiva e la funzionalità. I carrelli sono in acciaio. Il mod. MAC 1200 ST offerto presenta caratteristiche tecniche decisamente superiori rispetto agli altri modelli, luttavia la commissione ritiene che le caratteristiche migliorative contrastano con le finalità d'uso, atteso che le apparecchiature oggetto del presente lotto sono da destinare agli ambulatori di guardia medica, per i quali non si necessita di apparecchiature particolarmente sofisticate, più idonee a un reparto di Cardiologia.</p>	18,75	18,75	3	1	0	41,5	
		Elettrocardiografo mod. MAC 1200 ST di cui 13 c/carrello								
		Elettrocardiografo mod. MAC 5000 c/carrello								
		Carrello per emergenza EXPER mod. PERSOLIFE								
Ditta	Medical	Defibrillatore SEDA mod. Zoll Aed Plus PAD 100, di cui tre c/carrello Galeno cod. 1211PR	<p>Escluso. Gli ECG offerti non stampano in formato A4 come richiesto.</p>							
		Elettrocardiografo Nihon Kohden cod. ECG-9620R di cui 13 c/carrello Nihon Kohden cod. KD-103E								
		Elettrocardiografo Nihon Kohden cod. ECG-9622R c/carrello Nihon Kohden cod. KD-103E								
		Carrello per emergenza Galeno cod. 1211PR								
Ditta	Modesto Manca	Defibrillatore mod. Defibtech LifeLine AED	<p>Si esclude in quanto il lotto è incompleto. La Ditta ha presentato offerta per i soli defibrillatori.</p>							
		non offre ECG								
		non offre ECG								
		non offre il carrello								

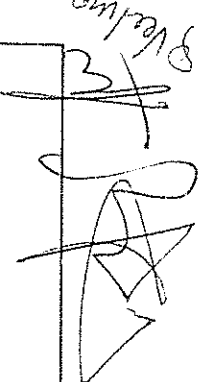

 lu Di⁴

 lu Di⁴

 lu Di⁴

Prospetto comparativo prodotti

Lotto 2	n° 25 Defibrillatori (di cui 3 con carrello) - n° 35 Elettrocardiografi (di cui 13 con carrello) - n° 1 Elettrocardiografo con carrello - n° 22 carrelli per emergenza	Modello	Valutazione	B1 - punti 23/60 (migliore e migliore dotazione e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9001: 2000 vision = 3 punti))	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Ditte manutentrici)	Totale punti
	Nuova Sarda Medicali	Defibrillatore Powerheart cod. PWG3 PRO, di cui tre c/carrello Elettrocardiografo cod. BTL-08-LT di cui 13 c/carrello cod. BTL-TR-M Elettrocardiografo cod. BTL-08-LT c/carrello LARIS Carrello per emergenza GENIUS cod. MS 22	Escluso Si esclude in quanto il carrello per emergenza offerto non è dotato di lucchetto a sirappo come richiesto.						
Ditta	Prodifarm	Defibrillatore Welch Allyn Mod. AED 10, di cui tre c/carrello PAM Elettrocardiografo CARDIMAX FX 7402 orig. FUKUDA di cui 13 c/carrello PAM Elettrocardiografo CARDIMAX FX 7402 orig. FUKUDA del carrello PAM Carrello per emergenza LUXOR MS21	Conforme. Discreta la qualità costruttiva e la funzionalità.	18,75	18,75	3	2	3	45,5
	Sanifarm	Defibrillatore PARAMEDIC mod. CU-ER1 di cui tre c/carrello Nuova Alaris cod. CARSPEC15/45C Elettrocardiografo DEL DR LEE mod. 310B cod. 310 di cui 13 c/carrello Nuova Alaris cod. CARSPEC15/45C Elettrocardiografo BIONET mod. RADIO TOUCH 1 c/carrello cod. CARSPEC15/45C Carrello per emergenza CFS mod. LUXOR cod. LUXOR	Escluso Escluso L'ECG mod. 310 B non stampa in formato A4 come richiesto.						

Alu D
Dr. Luigi Ferrero
Allyn
Value

Prospetto comparativo prodotti

Lotto 2	n° 25 Defibrillatori (di cui 3 con carrello) - n° 35 Elettrocardiografi (di cui 13 con carrello) - n° 1 Elettrocardiografo con carrello - n° 22 carrelli per emergenza	Modello	Valutazione	B1 - punti 23/60 (migliore dotazione e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9001: 2000 vision = 3 punti)	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001: 2000 Dille manufatturici)	Totale punti
Ditta	Terapon	Defibrillatore LAERDAR mod. HS1 cod. M3840 di cui tre c/carrello HS1	<p>Conformi. Buona la qualità costruttiva e la funzionalità.</p>	22,25 23,75	23,75 22,5	1	2	0	49,25
		Elettrocardiografo Philips mod. PageWriter TRIM 1 cod. 860288 di cui 13 c/carrello Elettrocardiografo Philips mod. PageWriter TRIM II cod. 860288 c/carrello Carrello per emergenza VIVIAM mod. Armstrong cod. ABL243110							
	Tarapon - Alternativa	Defibrillatore LAERDAR mod. HS1 cod. M3840 di cui tre c/carrello HS1 Elettrocardiografo Philips mod. PageWriter TRIM II cod. 860288 di cui 13 c/carrello Elettrocardiografo Philips mod. PageWriter TRIM II cod. 860288 c/carrello Carrello per emergenza VIVIAM mod. Armstrong cod. ABL243110	<p>Conformi. Buona la qualità costruttiva e la funzionalità. Il mod. Philips mod. PageWriter TRIM II cod. 860288, offerto in alternativa presenta caratteristiche tecniche decisamente superiori rispetto agli altri modelli, tuttavia la commissione ritiene che le caratteristiche migliorative contrastano con la finalità d'uso, atteso che le apparecchiature oggetto del presente lotto sono da destinare agli ambulatori di guardia medica per i quali non si necessita di apparecchiature particolarmente sofisticate più idonee a un reparto di Cardiologia.</p>	22,25	20	1	2	0	45,25

N.B. J'efforons le concession e le subissioni
 Del sottogruppo sotto Terapon gppri
 Alternative
 K. P. 6
 P. Augustini
 B

Prospetto comparativo prodotti

Lotto 3	n° 22 Negativoscopi	Modello	Valutazione	Punti					Totale punti
				B1 - punti 23/60 (migliore e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazioni qualità (ISO 9001: 2000 vision = 3 punti)	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Dite manufatturici)	
	Anamed	cod. M612043	Conforme. Tre sezioni utilizzabili separatamente. Dim 120x43 cm	20	19	1	3	0	43
	Axosan Gross	GIVAS Art. AN6008	Conforme. Dim. 93x48	15	20	1	1	0	37
	Axosan Gross - Alternativa	GIVAS Art. AN6010	Conforme. Dim. 127x48	20	19	1	1	0	41
	Electromedical	Europrotex Standard cod. 085973	Conforme. Struttura acciaio verniciato. 4500 *K. Dim. 90x43	15	20	3	3	3	44
	Electromedical - Alternativa	Europrotex Standard cod. 085974	Conforme. Struttura acciaio verniciato. 4500 *K. Dim. 120x43	20	19	3	3	3	48
	Formosa	TITANOX cod. M612043	Conforme. Tre sezioni utilizzabili separatamente. Dim 120x43 cm	20	15	1	2	3	41
	Formosa - Alternativa	TITANOX cod. M612043/GM	Conforme. Due sezioni con varia luce. Dim 80x43 cm	20	20	1	2	3	46
	Medical	Galeno cod. 2908	Conforme. Struttura in acciaio inox. Dim 120x43	20	19	3	2	3	47
	PS Medical	CABLAS cod. M-NP-90	Conforme. Struttura in acciaio verniciato. Dim 92x52. 6000 *K	15	14	0	4	0	33
	PS Medical - Alternativa	CABLAS cod. M-NP-120	Conforme. Struttura in acciaio verniciato. Dim 125x52. 6000 *K	20	20	0	4	0	44
	Sanifarm	Phoenix cod. NF102	La documentazione presentata è carente della scheda tecnica e dei depliant. Non valutabile si esclude.	Escluso					
	Sirio Medical	cod. ARD 3404INOX	Conforme. Struttura in acciaio inox. Dim 120x43	20	19	1	3	0	43
	Terapon	Europrotex mod. Standard cod. 085974	Conforme. Struttura acciaio verniciato. 4500 *K. Dim. 120x43	20	19	0	2	0	41
	Terapon - Alternativa	Europrotex mod. Standard cod. 085973	Conforme. Struttura acciaio verniciato. 4500 *K. Dim. 90x43	15	20	0	2	0	37
	Modesto Manca	mod. SLIM VIEW BOX cod. NGHSVB-1L	Si esclude in quanto nell'offerta senza prezzi è stato riportato il relativo costo.	Escluso					
	Modesto Manca - Alternativa	mod. SLIM VIEW BOX cod. NGHSVB-2L	Si esclude in quanto nell'offerta senza prezzi è stato riportato il relativo costo.	Escluso					

Data

[Handwritten signatures and notes]
 7
 Anamed
 Axosan
 Electromedical
 Formosa
 Medical
 PS Medical
 Sanifarm
 Sirio Medical
 Terapon
 Modesto Manca

pm

Prospetto comparativo prodotti

Lotto 4 n° 22 Lampade sciatitiche	Modello	Valutazione	B1 - punti 23/60 (maggior e migliore dotazione e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9001: 2000 vision = 3 punti)	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Dille manufatturici)	Totale punti
Elettromedical	mod. GIMANORD cod. 30751	Si esclude in quanto il numero di lux è nettamente inferiore alla richiesta. Trattasi di lente di ingrandimento con lampada fluorescenza specifica per dermatologia e non per piccola chirurgia.						
Formesa	GIMA cod. 30700	Si esclude in quanto non dotata di lente di ingrandimento.						
Prodiffarm	Welch Alllyn mod. LS200	Si esclude in quanto non dotata di lente di ingrandimento.						
Ditta	PS Medical cod. 2736 + 2737	Si esclude in quanto la lente di ingrandimento autoilluminante è separata dalla lampada scialta offerta. Ingonfiante, non funzionale.						Lotto Deserto
Sanifarm	TRUMPF mod. Heilon S Mobile	Si esclude in quanto non dotata di lente di ingrandimento.						
Sirio Medical	cod. LPD 5130 ST1	Si esclude in quanto il numero di lux è nettamente inferiore alla richiesta. Trattasi di lente di ingrandimento con lampada fluorescenza specifica per dermatologia e non per piccola chirurgia.						
Technos	mod. MACH 115 art. 1151.1012.00	Si esclude in quanto non dotata di lente di ingrandimento.						

3
elctive
Aug. 2011
8




Fun

Prospetto comparativo prodotti

Lotto 6	Studio Odontoiatrico	Modello	Valutazione	B1 - punti 23/60 (migliore e migliore dotazione e qualità costruttive)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9001: 2000 vision = 3 punti)	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Dite manufatturieri)	Totale punti
	<p>Medical</p>	<p>Riunito CEMM a faretra SONAR completo di accessori, Kit abbiatore SATELEC con inserti, n° 2 seggiolino odontoiatrico ANDY/AS, KIT lampada polimerizzatrice Satelec Mini led</p> <p>Radiografico De Gothen X Genus A/C - seggiolino CEMM cod. 929005 - Radiobisturi ELLMANN - Vasca di lavaggio + accessori mod. TECNIA 3 - sistema di illuminazione DEMARCO Demalight 458E - Sterilizzatore mod. Europa B XP cod. 2028-S - Termoisolatore Smeq cod. GW2050H - motore di aspirazione Cattiani ad anello umido mod. Turbo-Jet 1 Modular - Comprensore Cattiani completo di essiccatore - Sigillatrice Tecnogaz mod. OPERA cod. 2040-S - Lampada Polimerizzatrice Vivadente Astralis 7 cod. 557546 - Vibratore per amalgama De Giorgi cod. 721160 - Visore per panoramiche Tecnogaz cod. 7086/N - Set Strumentario</p>	<p>Valutazione</p>						
Dite	<p>S.T.D. Sistemi e Tecnologie Dentali</p>	<p>Riunito SIRONA C8 PLUS "BASIC" con tecnologia S.P.I.R.D.O.a faretra SONAR completo di accessori</p> <p>Radiografico Sirona HELIODENT VARIO - seggiolino Sirona C - Elettrobisturi De Giorgi 645/00 - Vasca di lavaggio Euronda Eurosonic 4D - sistema di illuminazione DEMARCO Demalight 458WEDE - autoclave Sirona SIROCLAVE B - Termoisolatore SIRONA SIROCLEAN - motore di aspirazione Cattiani ad anello umido mod. Turbo-Jet 1 - Comprensore Cattiani 070150 - Sigillatrice Sirona SIROSEAL - Lampada Polimerizzatrice MECTRON BLUELIGHT S - Vibratore per amalgama DE GOETZEN SOFTLY 8 - Visore per panoramiche EURONDA NEU30 - Contrangolo doppio anello verde KAVO 3630 - Set Strumentario</p>	<p>Valutazione</p>						

Lotto Deserto

Stelme

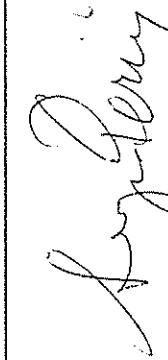for   

Prospetto comparativo prodotti

Lotto 6	Apparecchio per Micrometodi	Modello	Valutazione	B1- punti 23/60 (migliore dotazione e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9001: 2000 vision = 3 punti))	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Ditto manufatturici)	Totale punti
	A. De Mori	ABL 77 FULL	Non conforme. Si esclude in quanto non esegue l'emocromo	Escluso					
	A. De Mori - Alternativa	ABL 720	Non conforme. Si esclude in quanto non esegue l'emocromo	Escluso					
Ditta	Instrumentation Laboratory	Analizzatore mod. Coulter ACT Diff 2 cod. 016605500 + omegasanalizzatore mod. GEM Premier 3000 cod. 0057000200 + Capillari opartnati cod. 0007071500	Conforme. Ottima la qualità costruttiva, la tecnologia e funzionalità.	23	27	1	0	3	54
	Voden Medical Instruments	OSMETECH mod. OPTICCA cod. GD7045 + ABX mod. MICROS 60CT cod. M60CT	Conforme. Buona la qualità costruttiva, ottima la tecnologia e funzionalità.	20	27	0	2	3	52

Lu D¹⁰

Luigi Berio

Chelone

[Signature]

fu

Prospetto comparativo prodotti

Lotto 7	Spitometro	Modello	Valutazione	B1- punti 23/60 (maggiore e migliore dotazione e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9001: 2000 vision = 3 punti)	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Ditta manifatturici)	Totale punti
	Elettromedical	COSMED mod. QUARK PFT2 completo di accessori	Conforme	23	27	3	3	3	59
Ditta	Formesa	GIMA cod. 33486	Non conforme in quanto non esegue il volume residuo	Escluso					

fu

Escluso

Augusto

11

Prospetto comparativo prodotti

Lotte	Polissonnigrafo	Modello	Valutazione	B1- punti 23/60 (maggior e migliore dotazione e qualità costruttive)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9001: 2000 vision = 3 punti)	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Dille manufatturici)	Totale punti
	Anamed	MOD. EMBLETTA MEDCARE COD. FL1030001	Conforme. Buona la tecnologia e qualità costruttiva. Software versatile.	23	27	1	4	0	55
	Elettromedical	COSMED mod. SOMNOSCREEN RC cod. A661700001 + n° 2 Somnoscreen sensore di movimento per PLM cod. A661970013	Conforme. Buona la tecnologia e qualità costruttiva.	20	20	3	4	3	50
Ditta	Linda Gas Italia	mod. SLEEPSCREEN 9JA002	Conforme. Buona la tecnologia e qualità costruttiva.	20	23	3	4	3	53
	Sapio Life	EMBLETTA X10	Conforme. Buona la tecnologia e qualità costruttiva. Software versatile.	23	27	1	3	1	55
	Vivisol	WEINMANN mod. SOMNOCHECK EFFORT cod. 25066	Conforme. Discreta la tecnologia e qualità costruttiva.	15	18	13	4	13	43




 12



 Pleinwe







 43



fu

Prospetto comparativo prodotti

Lotto 9	Sistema motorizzato	Modello	Valutazione	B1 - punti 23/60 (migliore a migliore dotazione e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9001: 2000 vision = 3 punti)	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Ditte menutrici)	Totale punti
Stryker Italia		Stryker vari codici	Non Conforme. Non c'è un'unica centralina multifunzione sia macro che micro; i manipoli sono diversi e non uno completo dei vari accessori che consente la possibilità di regolare le funzioni del manipolo da campo sterile, non offre il mandrino senza chiave.	Escluso					
Ditta	Technos	Linvatec vari codici	Conforme. Buona la qualità costruttiva, la funzionalità e tecnologia	23	27	1	3	0	54

Stelvio

Luigi

13

Prospetto comparativo prodotti

Lotto 10	n° 7 Aspiratori chirurgici	Modello	Valutazione	B1 - punti 23/60 (maggiore e migliore dotazione e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9001: 2000 vision = 3 punti)	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Dille manifatturiche)	Totale punti
	<i>Air Liquide Sanità</i>	Flowmeter mod. RV/1000 - MAK4000 cod. 4604294	Non Conforme. Trattasi di unità di aspirazione a carrello con attacco a impianto centralizzato per aria compressa (manca motore) e non di aspiratore autonomo.						
	<i>Formesa</i>	Faset cod. 208	Conforme. 50 lt 2 vasi da 3 lt.	15	18	1		3	37
	<i>Nuova Sarda Medicali</i>	TECNO 100 cod. 146-A	Conforme. 100lt min	18	18	3	3	3	46
	<i>Prodifarm</i>	MEDAP mod. BORA UP2080 OP+C141	Conforme	18	22	3	2	3	49
	<i>PS Medical</i>	GIMA mod. TOBI CLINIC cod. 28215	Conforme. 60lt/min - 2 bottiglie da 4 lt	18	18	1	2,5	0	39,5
	<i>Sanifarm</i>	Pollivac B4SLT 60-2	Conforme. 50lt/min - 3 bottiglie da 4 lt	18	18	1	4	3	44
	<i>Sirio Medical</i>	mod. ES 2 cod. 0100103	Conforme. 70lt/min.	15	18	1	2,5	0	36,5
	<i>Sirio Medical - Alternativa</i>	mod. ES 2PO cod. 0100103PO	Conforme. 65lt/min.	15	18	1	2,5	0	36,5
	<i>Technos</i>	Medela mod. Dominant carrello ART. YRE70050 + SET riutilizzabile art. YRE70706	Conforme. 50 lt/min. fra i modelli offerti è quello più innovativo come design e tecnologia e qualità costruttiva	21	25	1	1	0	48

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Stelvio*
 - Middle right: *Stelvio*
 - Bottom right: *Stelvio*
 - Far right: *Stelvio*

Prospetto comparativo prodotti

Lotto 11 n° 1 Aspiratore portatile	Modello	Valutazione	B1- punti 23/60 (maggior parte migliore dotazione e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9000= 1 punto; ISO 9001: 2000 vision = 3 punti)	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (Certificazioni UNI EN ISO 9001:2000 Dite manufatturiche)	Totale punti
<i>Formesa</i>	Faset cod. 218	Conforme. Discreta qualità costruttiva, sufficiente funzionalità, autonomia 60'.	17	15	0	2	3	37
<i>Nuova Sarda Medical</i>	Tecno-16B cod. 111-A	Conforme. sufficiente qualità costruttiva e funzionalità, non specifica autonomia della batteria.	15	15	3	4	3	40
<i>Prodifarm</i>	MEDAP mod. VENTA CC	Conforme. Discreta qualità costruttiva o funzionalità, non specifica autonomia della batteria.	20	18	3	2	3	46
<i>PS Medical</i>	GIMA mod. SUPER TOBI cod. 28240	Conforme. Discreta qualità costruttiva, sufficiente funzionalità non specifica autonomia della batteria.	17	15	1	3	0	36
<i>Sito Medical</i>	mod. ESMU 220-12 cod. 0100202	Conforme. sufficiente qualità costruttiva e funzionalità, autonomia della batteria 90'.	15	18	1	3	0	37
<i>Technos</i>	Modello mod. VARIO (AC/DC) ART. YRE05034 + SET riutilizzabile art. YRE70715	Conforme. buona qualità costruttiva e funzionalità, autonomia della batteria 30'.	20	19	1	1	0	41

Ditta

Handwritten signatures and notes:
 - A large signature at the top right.
 - A signature in the middle right with the word "Oliviero" written below it.
 - A signature at the bottom right with the number "15" written next to it.

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°7

CARBONIA (CA)

Oggetto: Verbale della Commissione di aggiudicazione pubblico incanto per la fornitura ed installazione "Chiavi in mano" di apparecchiature e attrezzature per le Sedi di Continuita' Assistenziale - Pediatria e Pneumologia PO F.Ili Crobu - Traumatologia PO CTO - Servizi Diversi, compreso contratto di manutenzione assicurativa quinquennale.

Addì 19 del mese di luglio dell'anno 2004 alle ore 10,00, nella sede della USL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta pubblica la commissione di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, presieduta dal Geom. Gerolamo Agulli e composta come segue:

Dr. Marco Sulcis	Componente
Dr. Marco Grussu	Componente
Dr. Rinaldo Aste	Componente
Dr. Pietro Greco	Componente
Dr. Sergio Perisi	Componente
Dr. Piero Caddeo	Componente
Sig.ra Alessandra Ventura	Segretario

per la continuazione dei lavori della gara in oggetto.

Sono presenti i Sigg.: Massimo Fenu per la Ditta Prodifarm, Stefano Mereu per la Ditta GE Medical Systems Informatio, Domenico Porcu per la Ditta Sanifarm, Alessandro Marcias per la Ditta Elettromedical, Mauro Cocco per la Ditta Esaote, Paolo Paderi per la Ditta Technos, Luigi Piras per la Ditta S.T.D., Mario Lai per la

Ditta Voden Medical Instruments, Immacolata Flore per la Ditta Sirio Medical, Marco Puddu per la Ditta Formesa, Paolo Massoni per la Ditta Nuova Sarda Medicali, Enrico Corona per la Ditta Terapon, Giancarlo Piras per la Ditta Linde Gas Italia, Marco Marras per la Ditta Euromed Sardegna.

Si da lettura del verbale in data 13.07.2004 concernente la valutazione tecnico qualitativa delle apparecchiature offerte.

La commissione, previa verifica dell'integrità del plico contenente le offerte economiche, procede all'apertura delle medesime e constata quanto riportato nel prospetto prezzi allegato, costituito da n° 6 (sei) pagine e parte integrante del presente verbale.

Considerando i prezzi riportati nell'allegato prospetto prezzi, la Commissione procede all'attribuzione del punteggio per il prezzo secondo quanto dispone l'Art. 10 punto A del Capitolato Speciale.

Il punteggio complessivo ottenuto, punteggio qualità sommato al punteggio prezzo, risulta dal medesimo prospetto prezzi allegato.

Sulla base dei punteggi ottenuti la Commissione propone la seguenti aggiudicazione:

- Lotto 1-Ditta Sanifarm
- Lotto 2-Ditta Terapon-1^ proposta
- Lotto 3-Ditta Axosan Gross
- Lotto 4-Deserto
- Lotto 5-Deserto
- Lotto 6-Ditta Voden Medical Instruments
- Lotto 7-Ditta Elettromedical
- Lotto 8-Ditta Vivisol

Sirio Piras
Marco Puddu
Paolo Massoni
Enrico Corona
Giancarlo Piras

Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5

Marco Marras

Manfredi
Alex
Manfredi
Manfredi
Manfredi
Manfredi
Manfredi

Lotto 9-Ditta Technos

Lotto 10-Ditta PS Medical

Lotto 11-Ditta Prodifarm

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene inoltrato al Direttore per gli atti di rito.

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO

I TESTI

Stefano De Luca

[Handwritten signatures of the President and other officials]

[Handwritten signatures of the Commission members]

[Handwritten signature]

PROSPETTO PREZZI

· Pubblico incanto fornitura di apparecchiature e attrezzature per le Sedi di Continuità Ass.le - Pediatria e Pneumologia F.III Crobu ecc.

Lotto	Descrizione	Anamed	Akesan Gross	Elettromedical	Euromed Sardegna	Formosa	Formosa - Alternativa	Medical	Nuova Sarda Medical	PS Medical
1	n° 22 sterilizzatrici	S ANDROMEDA VACCUM XP TECNO-GAZ COD. 2052-S	AMS GALENO MOD. EGLE ART.402	ANDROMEDA VACCUM cod. 35651	LIARRE mod. STARCLAVE NEW PRINT ART. 159	ANDROMEDA PLUS XP	ANDROMEDA VACCUM XP	ANDROMEDA VACCUM XP cod. 2052-S	ANDROMEDA VACCUM XP cod. 2052-S	Galeno mod. EGLE cod. 402 + stampante mod. 403/1
	Prezzo	2.387,00	4.150,00	2.836,00	2.150,00	1.922,00	2.193,00	2.784,00	2.600,00	3.570,00
	Prezzo contratto quinquennale di manutenzione	1.185,00	1.676,00	734,10	1.250,00	964,00	1.096,50	1.390,00	772,72	2.150,00
	Totale prezzo	3.572,00	5.826,00	3.570,10	3.400,00	2.883,00	3.289,50	4.174,00	3.372,72	5.720,00
	Punteggio qualità	41,50	37	46,50	40,50	38,50	40,50	45,50	46,50	37,00
	Punteggio prezzo	32,28	19,65	32,30	33,91	40	35,05	27,64	34,19	20,16
	Totale punteggio	73,78	56,65	78,80	74,41	78,50	75,55	73,14	80,69	57,16
Lotto	Descrizione	S.D.T. Sistemi e Tecnologie Dentali	Sanifarm	Sirio Medical	Tecnicos					
1	n° 22 sterilizzatrici	Sirona SIROCLAVE B + Stampante SEIKO DPU 414	TECNO-GAZ mod. VACCUM XP COD. 2052-S	Stericlave 18S Dynamica cod. STERIL 18SEPRINT c/stampante art. AMT455	DELTA RT45					
	Prezzo	2.950,00 886,36 3.900,00	2.600,00 300,00	3.650,00 3.000,00	3.699,00 554,85 384,					
	Prezzo contratto quinquennale di manutenzione	383,6,36	2.900,00	6.650,00	3.253,85					
	Punteggio qualità	38,50	46,00	41,50	35,00					
	Punteggio prezzo	30,06	39,76	17,87	35,14					
	Totale punteggio	68,56	85,76	59,37	70,14					

D. Finley · *Adto Angeli* · *for value* · *Paolo*

PROSPETTO PREZZI

Publico incanto fornitura di apparecchiature e attrezzature per le Sedi di Continuità Ass.le - Pediatria e Pneumologia F.lli Crobu ecc.

Lotto	Descrizione	Axosan Gross	Elettromedicale	Elettromedicale - Alternativa	Esasote	Euromed Sardegna	GE Medical Systems Information Technologies	Profifarm	Terapion	Terapion - alternativa
2	A) n° 25 Defibrillatori (di cui 3 con carrello) - B) n° 35 Electrocardiografi (di cui 13 con carrello) - C) n° 1 Electrocardiografo con carrello - D) n° 22 carrelli per emergenza	A) MOD. REANIBEX - 200 + mod. AV PAM - B) CARDIOLINE MOD. DELTA 60 PLUS + Carrello mod. G.PAM - C) CARDIOLINE MOD. ELAN + Carrello mod. G.PAM - D) DIGALENO mod. LUXOR Art. MS21	A) MOD. LIFELINE AED DEFIBTECH di cui tre c/carrello - B) CARDIETTE MOD. ar 2100 view di cui 13 c/carrello - C) CARDIETTE MOD. ar 2100 view di cui 13 c/carrello - D) GIVAS + Cod. CP0020 + CP079	A) MOD. LIFELINE AED DEFIBTECH di cui tre c/carrello - B) MODIARA Rangoni mod. ELI 210 di cui 13 c/carrello - C) CARDIETTE MOD. ar 2100 view di cui 13 c/carrello - D) GIVAS + Cod. CP0020 + CP079	A) SCHILLER MOD. PRED easy di cui tre c/carrello - B) ESAOTE mod. P 8000 POWER BASE di cui 13 c/carrello - C) ESAOTE mod. P 8000 + Cod. CP0020 + CP079 - D) EXPER LIFELINE LEC 53	A) MOD. LIFERAK LP 500 BIFASICO Cod. 99401, di cui tre c/carrello cod. 27428 - B) mod. CARDIOTOUCH 3000S di cui 13 c/carrello cod. 27428 C) mod. MASTER cod. A-ABL243110	A) mod. RESPONDER AED, di cui tre c/carrello cod. SPECIALS - B) mod. MAC 1200 ST di cui 13 c/carrello - C) mod. MAC 5000 c/carrello - D) EXPER mod. PERSOLIFE	A) Welch Allyn Mod. AED 116, di cui tre c/carrello PAM - B) CARDIMAX FX 7402 orig. FUKUDA di cui 13 c/carrello PAM - C) CARDIMAX FX 7402 orig. FUKUDA c/carrello PAM - D) LUXOR MS21	A) LAERDAR mod. HST1 cod. M3840 di cui tre c/carrello HST1 - B) Philips mod. PageWriter TRIM 1 cod. 860290 di cui 13 c/carrello - C) Philips mod. PageWriter TRIM II cod. 860288 c/carrello - D) VIVIAM mod. Armstrong cod. ABL243110	A) LAERDAR mod. HST1 cod. M3840 di cui tre c/carrello HST1 - B) Philips mod. PageWriter TRIM II cod. 860288 c/carrello - D) VIVIAM mod. Armstrong cod. ABL243110
	Prezzo complessivo lotto	193.428,00	150.145,00	157.915,00	158.212,00	174.264,00	169.910,00	165.715,00	137.600,00	176.975,00
	Prezzo contratto quinquennale di manutenzione	60.980,00	26.336,00	26.336,00	55.379,00	86.500,00	62.750,00	13.231,00	21.345,00	29.270,00
	Totale prezzo	254.408,00	176.481,00	184.251,00	213.582,00	260.764,00	212.690,00	158.946,00	158.945,00	206.245,00
	Punteggio qualità	42,75	51,50	53	50,5	45,75	41,50	45,50	49,25	45,25
	Punteggio prezzo	34,99	36,02	34,05	29,76	24,38	29,89	40	39,98	30,82
	Totale punteggio	67,74	87,52	87,05	80,26	70,13	71,39	85,50	89,23 ok	76,07

Angelo Perini

for


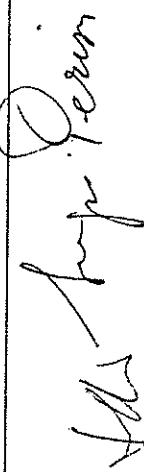


Padalco

optelme

Prospetto prezzi

Publico incanto fornitura di apparecchiature e attrezzature per le Sedi di Continuità Ass.le - Pediatria e Pneumologia F.Ili Crobu ecc.

Lotto	Descrizione	Anamed	Axosan Gross	Axosan Gross - Alternativa	Electromedical	Electromedical - Alternativa	Formosa	Formosa - Alternativa	Medical	PS Medical
3	n° 22 Negativoscopi	cod. M612043	GIVAS AIR AN6008	GIVAS AIR AN6008	Europrex Standard cod. 085973	Europrex Standard cod. 085974	TITANOX cod. M612043	TITANOX cod. M612043/IGM	Galeno cod. 2908	CABLAS cod. M-NP-90
	Prezzo	217,00	160,00	185,00	268,30	289,00	192,80	218,00	262,65	166,00
	Prezzo contratto quinquennale di manutenzione	185,00	—	—	45,15	52,25	85,00	110,00	130,00	250,00
	Totale prezzo	402,00	160,00	185,00	313,45	341,25	257,80	328,00	392,65	416,00
	Punteggio qualità	43	37	41	44	48	41	46	47	33
	Punteggio prezzo	15,98	40	34,59	20,39	18,75	24,82	19,51	16,29	15,38
	Totale punteggio	58,92	77	75,59	64,39	66,75	65,82	64,51	63,29	48,38
Lotto	Descrizione	PS Medical	Siro Medical	Terapion	Terapion - Alternativa					
3	n° 22 Negativoscopi	cod. M612043	cod. ARD 3404/INOX	Europrex mod. Standard cod. 085974	Europrex mod. Standard cod. 085973					
	Prezzo	183,00	203,00	211,00	220,00					
	Prezzo contratto quinquennale di manutenzione	600,00	175,00	50,00	50,00					
	Totale prezzo	583,00	378,00	294,00	270,00					
	Punteggio qualità	44	43	41	37					
	Punteggio prezzo	10,97	16,93	21,76	23,70					
	Totale punteggio	54,97	59,93	62,76	60,70					
Lotto	Descrizione									
4	n° 22 Lampade scialitiche con lente di ingrandimento	DESERTO								
Lotto	Descrizione									
5	n° 1 Studio odontoiatrico	DESERTO								

-Pagina 3

verbiale prezzi gara GI - PCD Pireum ecc

Prospetto prezzi

Publico incanto fornitura di apparecchiature e attrezzature per le Sedi di Continuità Ass.le - Pediatria e Pneumologia F.II Crobu ecc.

Lotto	Descrizione	Instrumentation Laboratory	Vodon Medical Instruments
6	n° 1 Apparecchio per micrometodi	Analizzatore mod. Coulter ACT Diff 2 cod. 016605500 + emogasanalizzatore mod. GEM Premier 3000 cod. 0057000200 + Capillari epurati: cod. 0007071500	OSMETECH mod. OPTICCA cod. GD7045 + ABX mod. MICROS 80CT cod. M80CT
	Prezzo	21.000,00	20.765,00
	Prezzo contratto quinquennale di manutenzione	23.000,00	14.500,00
	Totale prezzo	44.000,00	35.265,00
	Punteggio qualità	54	52
	Punteggio prezzo	32,04	40
	Totale punteggio	86,04	92 OK
Lotto	Descrizione	Elettromedical	
7	n° 1 Spittometro	COSMED mod. QUARK PET2 completo di accessori	
	Prezzo	17.420,00	
	Prezzo contratto quinquennale di manutenzione	6.355,00	
	Totale prezzo	21.775,00	
	Punteggio qualità	59	
	Punteggio prezzo	40	
	Totale punteggio	99 OK	

Sperry *Sperry* *Sperry* *Sperry* *Sperry*

Sperry *Sperry* *Sperry* *Sperry* *Sperry*





Sperry *Sperry* *Sperry* *Sperry* *Sperry*

Sperry *Sperry* *Sperry* *Sperry* *Sperry*

Prospetto prezzi

Pubblico incanto fornitura di apparecchiature e attrezzature per le Sedi di Continuità Ass.le - Pediatria e Pneumologia F.III Crobu ecc.


Lotto	Descrizione	Anamed	Elettromedical	Linde Gas Italia	Sapio Life	Vivisol
3	n° 1 Polissonnigrato	MOD. EMBLETTA MEDCARE COD. FL1030001	COSMED mod. SOMNOSCREEN RC cod. A661700001 + n° 2 Somnoscreen sensore di movimento per PLM cod. A661970013	mod. SLEEPSCREEN 9JA002	EMBLETTA X10	WEINMANN mod. SOMNOCHECK EFFORT cod. 25066
	Prezzo	14.570,00	9.020,00	16.355,00	9.780,00	6.250,00
	Prezzo contratto quinquennale di manutenzione	22.500,00	2.255,00	5.500,00	2.368,00	1.400,00
	Totale prezzo	37.070,00	11.275,00	21.855,00	12.148,00	7.650,00
	Punteggio qualità	55	50	53	55	43
	Punteggio prezzo	8,25	27,13	14,00	25,39	40
	Totale punteggio	63,25	77,13	67,00	80,39	83 OK
Lotto	Descrizione	Technos				
9	Sistema motorizzato	Linvalec				
	Prezzo	48.231,30				
	Prezzo contratto quinquennale di manutenzione	28.998,78				
	Totale prezzo	77.230,08				
	Punteggio qualità	54				
	Punteggio prezzo	40				
	Totale punteggio	94 OK				

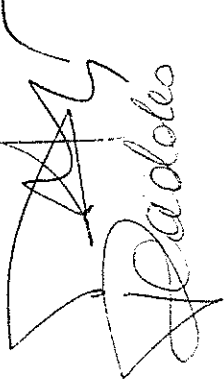





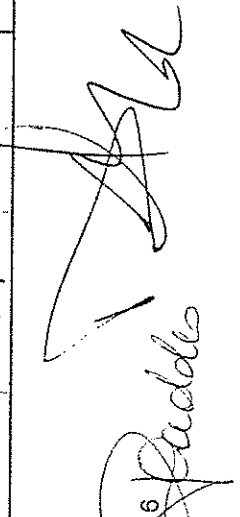
Prospetto prezzi


Pubblico incanto fornitura di apparecchiature e attrezzature per le Sedi di Continuità Ass.le - Pediatria e Pneumologia F.II Crobu ecc.

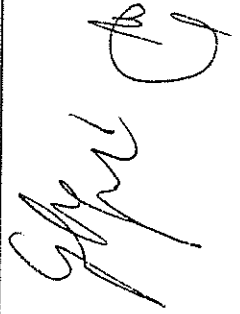Lotto	Descrizione	Formesa	Nuova Sarda Medicali	Prodifarm	PS Medical	Sanifarm	Sirio Medical	Sirio Medical - Alternativa	Technos
10	n° 7 Aspiratori	Faset cod. 208	TECNO 100 cod. 146-A	MEDAP mod. BORA UP2080 OP	GIMA mod. TOBI CLINIC cod. 28215	Polivac B4/SLT 50-2	mod. ES 2 cod. 0100103	mod. ES 2PO cod. 0100103PO	Medela mod. Dominant careliato ART. YRE70050 + SET riutilizzabile art. YRE70706
	Prezzo	2.257,00	1.200,00	1.650,00	660,00	1.408,00	1572,00	2.003,00	4.421,23 3.732,83
	Prezzo contratto quinquennale di manutenzione	1.128,50	571,42	165,00	650,00	200,00	115,00 238,00	1500,00	663,19
	Totale prezzo	3.385,50	1.771,42	1.815,00	1.310,00	1.608,00	2747,00	3503,00	5.085,42
	Punteggio qualità	39	45	48	39,50	44	36,5	36,5	48
	Punteggio prezzo	15,47	29,58	28,87	40	32,58	19,07	14,95	10,30
	Totale punteggio	54,47	74,58	76,87	79,50	76,58	64,57	64,45	58,30
Lotto	Descrizione	Formesa	Nuova Sarda Medicali	Prodifarm	PS Medical	Sirio Medical	Technos		
11	n° 1 Aspiratore portatile	Faset cod. 218	Tecno-16B cod. 111-A	MEDAP mod. VENTA CC	GIMA mod. SUPER TOBI mod. cod. 28240	ESMU 220-12 cod. 0100202	Medela mod. VARIO (AC/DC) ART. YRE05034 + SET riutilizzabile art. YRE70715		
	Prezzo	792,00	360,00	608,00	350,00	457,00	1782,45		
	Prezzo contratto quinquennale di manutenzione	396,00	2000,00	87,25	350,00	365,00	267,22		
	Totale prezzo	1188,00	2360,00	785,25	700,00	802,00	2048,67		
	Punteggio qualità	37	40	46	36	37	41		
	Punteggio prezzo	23,56	118,6	35,65	40	34,91	13,66		
	Totale punteggio	60,56	55,86	81,65	76	71,91	54,66		

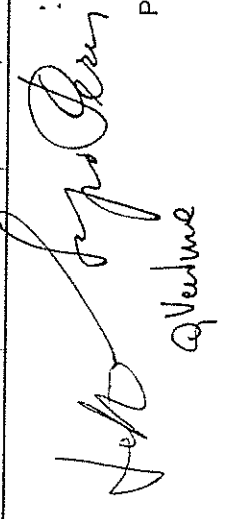







SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°7

CARBONIA (CA)

Oggetto: *Verbale della Commissione di aggiudicazione pubblico incanto per la fornitura ed installazione "Chiavi in mano" di apparecchiature e attrezzature per le Sedi di Continuità Assistenziale – Pediatria e Pneumologia PO F.lli Crobu – Traumatologia PO CTO – Servizi Diversi, compreso contratto di manutenzione assicurativa quinquennale.*

Addì 21 del mese di settembre dell'anno 2004 alle ore 10,00, nella sede della USL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata la commissione di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, presieduta dal Geom. Gerolamo Agulli e composta dal Dr. Marco Sulcis, dal Dr. Marco Grussu, dal Dr. Sergio Perisi, dal Dr. Pietro Greco, dal Dr. Rinaldo Aste, dal Dr. Piero Caddeo e dalla Sig.ra Alessandra Ventura con funzioni di segretario

La Commissione si è riunita a seguito della nota Prot. 108/DA del 15.09.2004, a firma del Direttore Amm.vo, con la quale la Commissione tutta è stata invitata a riunirsi in data odierna per esaminare le opposizioni della Ditta Elettromedical, nota Prot.14791 del 27.07.2004 e della Ditta Prodifarm, nota Prot. 15986 del 11.08.2004, allegate al presente verbale, relativamente alla valutazione tecnica effettuata dalla commissione per il lotto 2 e precisamente:

- a) Ditta Elettromedical: avanza opposizione in merito all'Elettrocardiografo offerto dalla Ditta Terapon alla voce B) del Lotto 2 – *Philips mod. Page-Writer Trim 1*. Nello specifico la Ditta evidenzia che l'apparecchiatura offerta è dotata di display non grafico che non permette la visualizzazione di

Gerolamo Agulli
Marco Sulcis
Marco Grussu
Sergio Perisi
Pietro Greco
Rinaldo Aste
Piero Caddeo
Alessandra Ventura

parametri vitali quali curve elettrocardiografiche e del tratto ST ecc., elementi visualizzabili solo in un monitor o in display grafico di "discrete dimensioni";

- b) Ditta Prodifarm: segnala alcune discordanze fra quanto richiesto dal Capitolato e quanto offerto da alcune ditte relativamente al lotto 2.

Nello specifico la Ditta evidenzia che:

- l'apparecchiatura offerta dalla Ditta Terapon per la voce B) del Lotto 2 – *Elettrocardiografo Philips mod. Page- Writer Trim 1*, non è dotata di monitor come richiesto dal Capitolato Speciale di gara, bensì di un display che non permette la visualizzazione delle tracce ECG;
- Il carrello di emergenza offerto dalla Ditta Elettromedical per la voce D) - del Lotto 2 - *GIVAS mod. CP0020*, non dispone della caratteristica richiesta "lucchetto a strappo" come confermato dallo stesso fornitore GIVAS.

La commissione nel prendere atto di quanto suesposto procede ad un attento riesame della documentazione tecnica.

La Commissione procede al riesame delle caratteristiche dell'apparecchiatura offerta dalla Ditta Terapon alla voce B) del Lotto 2, con particolare riferimento al monitor.

Relativamente al monitor il Capitolato Speciale riporta la seguente dicitura: "*Monitor di discrete dimensioni*".

Dopo attenta analisi la Commissione conferma le valutazioni assunte a suo tempo nei precedenti verbali per le seguenti motivazioni:

- La scheda tecnica e l'offerta della Ditta Terapon definiscono che l'apparecchio è dotato di monitor LCD;


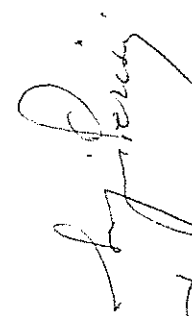



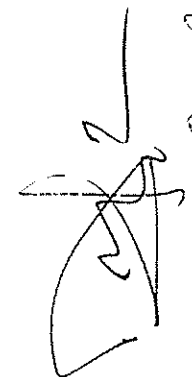

Handwritten notes and signatures:
- *Prodifarm*
- *Terapon*
- *Elettromedical*
- *GIVAS*
- *Commissione*
- *Prodifarm*
- *Terapon*
- *Elettromedical*
- *GIVAS*

- La commissione ritiene di non poter valutare pienamente, se non soggettivamente, l'indicazione riportata dal Capitolato di "discrete dimensioni";
- Il Capitolato non richiede *monitor ECG*, per cui le opposizioni avanzate dalla due ditte relativamente alla circostanza che il monitor dell'apparecchio della Ditta Terapon non consenta la valutazione del tracciato ECG, sono totalmente arbitrarie e suffragate dalla prescrizioni del Capitolato;
- La Commissione per quanto precede, non essendo richiesta la *traccia ECG* ritiene sufficienti le dimensioni del monitor dell'apparecchiatura offerta dalla Ditta Terapon;
- La Commissione inoltre, riesaminate le offerte e le schede tecniche delle Ditte Prodifarm ed Elettromedical, rileva che le medesime hanno dichiarato che i rispettivi apparecchi offerti sono dotati di "display".

A tal punto si evidenziano comunque la sovrapposibilità o sinonimia dei due termini. La commissione ritiene che la differenziazione sostanziale possa essere definita sulla base di quanto già detto, ovvero le opposizioni avrebbero potuto avere un fondamento di legittimità se la richiesta della ASL avesse contenuto la dizione *monitor/display ECG*, caratteristica non ritenuta necessaria in sede di stesura di capitolato, nella considerazione che gli ECG non sono destinati a reparti specialistici di cardiologia ma alle sedi di Guardia Medica.

La Commissione a tal punto considera, che se avesse dovuto prendere in esame la descrizione letterale indicata nelle offerte e nelle schede tecniche delle ditte ricorrenti, avrebbe dovuto legittimamente escludere le medesime dalla gara in quanto hanno offerto un apparecchio con display e non con monitor.

La Commissione procede al riesame delle caratteristiche del carrello offerto dalla Ditta Elettromedical.

 Padda
 P. P. P.
 P. P. P.
 P. P. P.
 P. P. P.
 P. P. P.
 P. P. P.


La Commissione riesaminata l'offerta e la scheda tecnica della Ditta Elettromedical, evidenzia che entrambe riportano l'attestazione che il carrello è fornito di lucchetto a strappo come dichiarato in offerta e di serratura di emergenza per carrelli come definita nella scheda tecnica, sottolineando che la stessa scheda tecnica evidenzia che il carrello è fornito corredato di n° 20 fascette a strappo di sicurezza.

La Commissione ai fini della valutazione dei lucchetti a strappo prende atto che la dizione non è riportata nelle diverse offerte con le stesse modalità; la ditta aggiudicataria li definisce sigilli a strappo o lucchetto. Peraltro la commissione ritiene comunque valido il prodotto offerto.


Per quanto sopra esposto, la commissione riconferma le valutazioni fatte a suo tempo per il Lotto 2, e respinge le opposizioni della Ditta Elettromedical e della Ditta Prodifarm.

Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto viene inoltrato al Direttore Generale per gli atti di rito.

IL PRESIDENTE

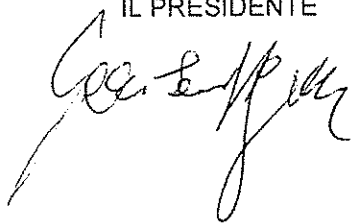


LA COMMISSIONE

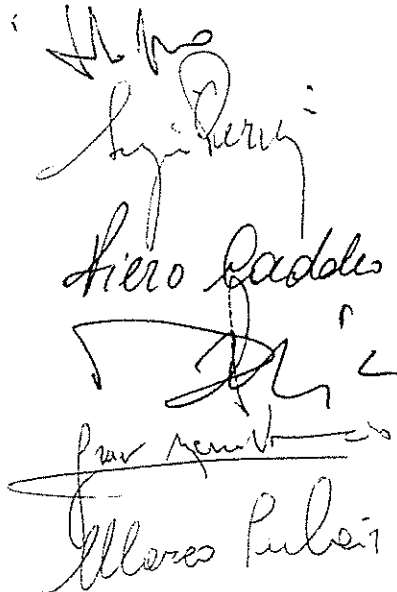

Stefano Paddes
Franco Paddes
Alessandro Pulcinella

IL SEGRETARIO



N. 108/DA di Prot.

Carbonia, 15/09/2004

Al Geom. Gerolamo Agulli	Presidente
Al Dr. Marco Grussu	Componente
Al Dr. Marco Sulcis	Componente
Al Dr. Rinaldo Aste	Componente
Al Dr. Sergio Perisi	Componente
Al Dr. Piero Caddeo	Componente
Al Dr. Pietro Greco	Componente
Alla Sig. ra Alessandra Ventura	Segretario

Loro Sedi

OGGETTO: Pubblico incanto per la fornitura di *apparecchiature e attrezzature per le Sedi di Continuità Assistenziale – Pediatria e Pneumologia PC F.lli Crobu – Traumatologia PO CTO – Servizi Diversi.*
Richiesta esame opposizione Ditta Elettromedical e Ditta Prodifarm
Convocazione.

Con riferimento all'appalto in oggetto, sono pervenute all'Azienda le note delle Ditte Elettromedical e Prodifarm concernenti opposizioni relative alla valutazione tecnica effettuata dalla commissione e precisamente:

- a) Ditta Elettromedical: avanza opposizione in merito all'Elettrocardiografo offerto dalla Ditta Terapon alla voce B) del Lotto 2 – *Philips mod. Page- Writer Trim 1*. Nello specifico la Ditta evidenzia che l'apparecchiatura offerta è dotata di display e non di monitor come richiesto dal Capitolato Speciale di gara;
- b) Ditta Prodifarm: segnala alcune discordanze fra quanto richiesto dal Capitolato e quanto offerto da alcune ditte relativamente al lotto 2.
Nello specifico la Ditta evidenzia che:
 - l'apparecchiatura offerta dalla Ditta Terapon per la voce B) del Lotto 2 – *Elettrocardiografi Philips mod. Page- Writer Trim 1*, non è dotata di monitor come richiesto dal Capitolato Speciale di gara, bensì di un display che non permette la visualizzazione delle tracce ECG;
 - Il carrello di emergenza offerto dalla Ditta Elettromedical per la voce D) - del Lotto 2 - *GIVAS mod. CP0020*, non dispone della caratteristica richiesta "lucchetto a strappo" come confermato dallo stesso fornitore GIVAS.

L'Azienda deve fornire riscontro in merito alle opposizioni.

Appare pertanto necessario che le SS.LL. si riuniscano in commissione per esaminare le opposizioni ed i relativi atti di gara in relazione a quanto argomentato dalle Ditte.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda ASL n.7
Carbonia

Si invita la Commissione tutta a voler fornire esaurienti e legittime motivazioni che confermino o meno la valutazione a suo tempo fatta, anche alla luce di possibili ed eventuali chiamate in causa nanti il TAR.

L'Azienda ha quindi necessità di avere la più ampia certezza di legittimità del proprio operato.

Per quanto sopra la Commissione è invitata a riunirsi inderogabilmente alle **ore 10,00 del giorno 21.09.2004** presso la sala appalti della Direzione Aziendale in Carbonia.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore Amm.vo
Dr. G. Antonio Fadda




A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Antonio Fadda", written over a faint horizontal line.



elettroMedical® snc

di GIORGIO BOSCATO & C.

Forniture Ospedaliere, Elettromedicali, Computers, Tecnologie Avanzate

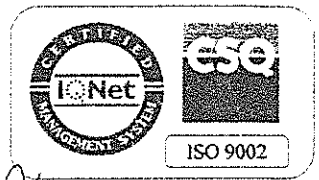

5

ABS 27/7/04

Sestu, 23 luglio 2004

27 LUG. 2004

PROT. 14972 A/a.

Spett.le
Azienda U.S.L. N°7
Via Dalmazia n°83
09013 CARBONIA CA

Alexandro

Geom. Gerolamo Agulli

*27/7/04
Gerolamo Agulli*

RACCOMANDATA A.R.

Gerolamo Agulli

OGGETTO: Bando di gara d'appalto per forniture diverse. Appalto b) Fornitura e installazione "chiavi in mano" di apparecchiature per sedi di Continuità Assistenziale, per Pediatria e Pneumologia P.O. F.lli Crobu, per Traumatologia P.O. CTO e per Servizi diversi compreso contratto di manutenzione assicurativa quinquennale. Aggiudicazione LOTTO N°2.

In riferimento all'oggetto della presente ed in particolare al LOTTO N°2 aggiudicato alla Ditta Terapon Srl di Cagliari, in cui si richiedevano:

A. N°25 Defibrillatore semiautomatico (di cui n°3 completi di carrello)

Caratteristiche:

- Ad onda bifasica
- Comandi, anche verbali, in italiano
- A 2 o 3 tasti (con tasto analisi)
- Batteria al litio o ricaricabile
- Software di alta qualità per l'interpretazione del segnale

B. N°35 Elettrocardiografo (di cui n°13 completi di carrello)

Caratteristiche:

- Almeno a 3 canali
- Dotato di monitor di discrete dimensioni
- Funzionamento manuale e automatico
- Funzionamento a batteria ricaricabile
- Stampa in dimensione A4

C. N°1 Elettrocardiografo completo di carrello

Caratteristiche:

- Almeno a 6 canali
- Dotato di monitor di discrete dimensioni
- Funzionamento manuale e automatico
- Funzionamento a batteria ricaricabile
- Stampa in dimensione A4

D. N°22 Carrello per emergenza

Caratteristiche:

- Dotato di ripiano porta defibrillatore e ECG
- Cassetti differenziati per farmaci e dotazione di emergenza
- Chiusura con lucchetto a strappo.

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA

27 LUG. 2004

PROTOCOLLO
PRIVATO

...../.....



elettroMedical[®] snc
di GIORGIO BOSCATO & C.

foglio n. _____

La Ditta Terapon Srl alla voce B rispondeva offrendo l'elettrocardiografo PHILIPS mod. PAGEWRITER TRIM 1, le cui caratteristiche tecniche, di cui alleghiamo copia, non contemplano il "monitor di discrete dimensioni" da Voi richiesto nel capitolato speciale, che invece è presente nel modello PHILIPS PAGEWRITER TRIM 2 offerto alla voce C dello stesso lotto.

Nel modello TRIM 1 è presente un display non grafico di quaranta caratteri suddivisi in due sole righe, che permette la sola visualizzazione di dati alfanumerici e non di parametri vitali quali curve elettrocardiografiche, informazioni sul tratto ST ecc., elementi visualizzabili solo in un monitor o in display grafico di "discrete dimensioni".

E' palese inoltre, che tutte le aziende partecipanti hanno risposto alla Vs. richiesta, proponendo elettrocardiografi dotati di monitor, e non di display alfanumerico, che anche nel ns. caso avrebbero permesso un'offerta decisamente più economica e concorrenziale.

Alla luce di quanto sopra esposto si evince che l'offerta della Ditta Terapon Srl di Cagliari non è conforme alle caratteristiche minime del Vs. capitolato speciale e pertanto dovrebbe essere esclusa.

Chiediamo quindi di rivedere la valutazione tecnica con conseguente aggiudicazione alla ns. società del lotto in oggetto.

In attesa delle Vs. determinazioni e di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Elettromedical s.n.c.
di Giorgio Boscato & C.
Un' Amministratore



1
 Vicepresidente ufficio fare
 il 03/08/04.
Prodifarm s.r.l.
 FORNITURE MEDICO CHIRURGICHE



4 + Dephian
 A le tre ditte
 di
 partire in
 Carbonia

PERVENUTA IL 12-08-04 ABS

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA
 11 AGO. 2004
 PROT. 15986 Acq.

Spett.le Azienda U.S.L. n. 7
 Ufficio Acquisti
 Via Dalmazia n. 83
 09013 Carbonia

Sassari, 06/08/2004

Prot. 130/mc

Oggetto: Gara d'appalto fornitura ed installazione "chiavi in mano" di apparecchiature per le sedi di continuità assistenziale - pediatria e pneumologia P.O. F.Ili Crobu - Traumatologia CTO - Servizi diversi

In riferimento alla gara in oggetto, vorremo segnalare alla Vs. Spett.le Azienda alcune discordanze fra quanto richiesto da capitolato e quanto offerto da alcune ditte relativamente al Lotto n. 2

- 1) Voce B: la ditta Terapon ha proposto n. 35 Elettrocardiografi Philips mod. Page-writer Trim 1. La stessa non offre il monitor come richiesto da capitolato, ma un display che non permette la visualizzazione delle tracce ECG (caratteristica univoca del monitor).
- 2) Voce D: la ditta Elettromedical propone il carrello per emergenza modello Saturno CPO020 della ditta Givas. Lo stesso non dispone della caratteristica richiesta "lucchetto a strappo" come confermato dalla stesso fornitore "Givas srl". L'eventuale inserimento di un lucchetto non originale Givas comporterebbe delle modifiche strutturali sul carrello con conseguente decadimento delle normative vigenti. A tal proposito alleghiamo catalogo linea Saturno e listino prezzi ufficiale Givas.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Prodifarm s.r.l.

Zona Industriale Predda Niedda
 Telefono 079.260521 - Fax 079.260640
 07100
 Sassari
 Via Trento, 86
 Telefono 070.271185 - Fax 070.274066
 09123
 Cagliari

Email: prodifarm@tin.it
 Capitale Sociale € 530.000,00 interamente versato
 ISCRIZIONE R.E.A. n° 56447 Sassari - Reg. Impr. Sassari 00138660907 - C.C.P. 10795070 - Codice fiscale e Partita IVA 00138660907

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°7

CARBONIA (CA)

Oggetto: *Verbale della Commissione di aggiudicazione pubblico incanto per la fornitura ed installazione "Chiavi in mano" di apparecchiature e attrezzature per le Sedi di Continuità' Assistenziale – Pediatria e Pneumologia PO F.lli Crobu – Traumatologia PO CTO – Servizi Diversi, compreso contratto di manutenzione assicurativa quinquennale.*

Addì 27 del mese di settembre dell'anno 2004 alle ore 10,00, nella sede della USL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta pubblica la commissione di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, presieduta dal Geom. Gerolamo Agulli e composta dai Sigg.:

Dr. Marco Sulcis	Componente
Dr. Marco Grussu	Componente
Dr. Rinaldo Aste	Componente
Dr. Pietro Greco	Componente
Dr. Sergio Perisi	Componente
Dr. Piero Caddeo	Componente
Sig.ra Alessandra Ventura	Segretario

Per il riesame della proposta di aggiudicazione del lotto 8, nonché del lotto 2.

Premesso che:

- le ditte partecipanti alla gara in oggetto sono state convocate alla seduta odierna con Telegramma Prot. ASL 3978 del 22.09.2004;



q.ventura






- è stato riscontrato errore materiale nella proposta di aggiudicazione del lotto 8 – Polissonigrafo, e nello specifico si è preso atto che i costi del contratto di manutenzione Full Risk proposti dalle Ditte Sapio Life e Vivisol, essenziali ai fini della valutazione economiche delle offerte, sono rispettivamente riferiti a *tre anni e un anno*, anziché a *cinque anni* come richiesto dal Capitolato.
- In data 21.09.2004 la Commissione si è riunita in seduta privata per l'esame delle opposizioni della Ditta Elettromedical e della Ditta Prodifarm, relativamente alla valutazione tecnica effettuata dalla Commissione medesima per il lotto 2, redigendo apposito verbale.

Tutto ciò premesso il Presidente dichiara aperta la seduta. Non è presente alcuna Ditta.


Prima di procedere alla rivalutazione delle offerte economiche del lotto 8, il Presidente ritiene di dover dare lettura del verbale della seduta privata della Commissione in data 21.09.2004, concernente l'esame delle opposizioni della Ditta Elettromedical e della Ditta Prodifarm, relativamente alla valutazione tecnica effettuata dalla commissione per il lotto 2. La Commissione conferma la precedente proposta di aggiudicazione del Lotto 2, a favore della Ditta Terapon, così come risulta dal verbale in data 19.07.2004.

La Commissione procede a un'attenta rivalutazione delle offerte economiche del lotto 8, evidenziando che, come già esposto in premessa, le Ditte Sapio Life e Vivisol hanno proposto un costo di contratto di manutenzione Full Risk riferito rispettivamente a *tre* e a *un anno*, mentre il Capitolato prevede un costo *quinquennale*, nello specifico le offerte testualmente recitano:

Ditta Sapio Life:

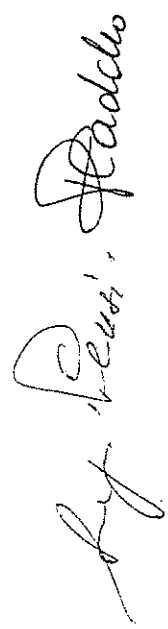

collezione

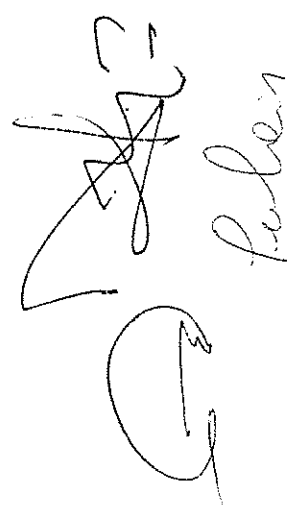

Luca

"Contratto di manutenzione FullRisk dopo il periodo di garanzia per Embleta X10, (durata 3 anni) Prezzo a Voi riservato € 2.268,00 +IVA"

Ditta Vivisol

" ...Contratto di manutenzione Full Risk successivo alla garanzia € 1.400,00/anno IVA esclusa..."

Pertanto, nel rispetto della par-condicio e delle prescrizioni del Capitolato, la Commissione rapporta i costi proposti dalle due Ditte a un periodo di cinque anni come segue:

Ditta Sapio Life:

Costo contratto manutenzione Full Risk per 1 anno	€ 756,00 (€ 2.268,00/3)
Costo contratto manutenzione Full Risk per 5 anni	€ 3.780,00

Ditta Vivisol:

Costo contratto manutenzione Full Risk per 1 anno	€ 1.400,00
Costo contratto manutenzione Full Risk per 5 anni	€ 7.000,00

La Commissione conferma i prezzi delle restanti Ditte.

Sulla base di quanto sopra riportato, i prezzi oggetto di valutazione del Lotto 8 sono quelli riportati nell'allegato prospetto, costituito da n° 1 pagina e parte integrante del presente verbale. Nel medesimo prospetto sono stati riportati i relativi *punteggi prezzo* e *punteggi complessivi* (punteggio prezzo sommato al punteggio qualità). Sulla base dei nuovi punteggi, la Commissione propone l'aggiudicazione del **lotto 8** in favore della **Ditta Elettromedical** che ha ottenuto il massimo punteggio (90/100).

La Commissione conferma le restanti proposte di aggiudicazione di cui al verbale in data 19.07.2004.


Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto viene inoltrato al Direttore

Quesada


Parben

Generale per gli atti di rito.

IL PRESIDENTE

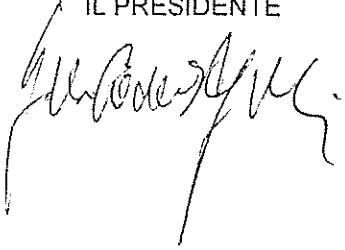

LA COMMISSIONE


Suggerisci
Piero Laddes
~~ALC~~
~~per revisione~~
Mores Pulei

IL SEGRETARIO

Stenanche Vantini .



Prospetto prezzi lotto 8 - Rettifica

Fornitura apparecchiature e attrezzature per le Sedi di Continuità Ass.le, PED. e PN. F.II Crobu ecc.

Lotto	Descrizione	Anamed	Elettromedical	Lindo Gas Italia	Sapio Life	Vivisol
8	n° 1 Polisomnigrato	MOD. EMBLETTA MEDCARE COD. FL1030001	COSMED mod. SOMNOSCREEN RC cod. A661700001 + n° 2 Somnoscreen sensore di movimento per PLM cod. A661970013	mod. SLEEPSCREEN 9JA002	EMBLETTA X10	WEIMANN mod. SOMNOCHECK EFFORT cod. 25066
	Prezzo	€ 14.570,00	€ 9.020,00	€ 16.355,00	€ 9.780,00	€ 6.250,00
	Prezzo contratto quinquennale di manutenzione	€ 22.500,00	€ 2.255,00	€ 5.500,00	€ 3.780,00	€ 7.000,00
	Totale prezzo	€ 37.070,00	€ 11.275,00	€ 21.855,00	€ 13.560,00	€ 13.250,00
	Punteggio qualità	55	50	53	55	43
	Punteggio prezzo	12,17	40,00	20,64	33,26	34,04
	Totale punteggio	67	90	74	88,26	77

Prosecco

Stelvio
per gestione

Mario Pulei

Stelvio
Stelvio
Stelvio

Documento composto di
n. 50 pagine fogli

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2550 DEL 19 NOV. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

