

Deliberazione 1884 del 18 GIU. 2001

Oggetto: manutenzione urgente apparecchiatura sanitaria.

IL DIRETTORE GENERALE


- acquisita** la formale regolare proposta del Responsabile dell'Unità Operativa di Pediatria Dr. Verrocchi, con la quale richiede la manutenzione urgente delle apparecchiature elettromedicali, confermata dalla Direzione Medica dei P.O. Sirai;
- atteso** che debesi confermare l'urgenza della manutenzione dell'apparecchiatura dell'Unità Operativa di Pediatria, affidata ai sensi dell'art. 7 p. 2 lett. b D.Lgv. 157/95 e successive integrazioni;
- considerato** che il Servizio Acquisti ha provveduto per gli adempimenti di competenza per garantire la continuità operativa, individuando la Ditta Bertocchi S.r.l.;
- sentito** il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


DELIBERA


- acquisire agli atti aziendali autorizzazione di intervento tecnico presso la Ditta Bertocchi S.r.l.;
- confermare che il costo presuntivo, da conguagliare a consuntivo, ammonta a £. 51.000.000 pari a Euro 26.339,30 oltre l'iva al 20% da imputarsi sulla classe di costo 54 05 00010 del piano dei conti Aziendale;
- demandare al **Capo Servizio Acquisti** di provvedere agli adempimenti di competenza;
- determinare che il **Capo Servizio Bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale.

DIR.AMM./ 

DIR.SAN./ 

ACQ/AGULLI 

SETT/ARCA 

ADD/MARICCA 



Il Direttore Generale
Simone

Azienda U.S.L. CARBONIA

Segue deliberazione n. 1887 del 18 GIU, 2001

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'Albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda per ~~dieci~~ giorni a decorrere dal 18 GIU, 2001 al 27 GIU, 2001

Responsabile del procedimento

Carta




IL RESPONSABILE

AFFARI GENERALI

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

Via Dalmazia 83 - 09013 Carbonia

PROT. N° 1153 ABS
Servizio Acquisti

Carbonia 08.06.01

Al Sig. Direttore Amministrativo

OGGETTO: Proposta intervento tecnico su apparecchiature sanitarie.

Vista la richiesta del Primario/responsabile dell'Unità Operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero Sirai, tendente ad ottenere l'adeguamento alle norme CE delle apparecchiature presenti nel reparto quali: n° 2 incubatrici, n° 2 culle termostatiche, n° 3 fototerapie, n° 1 ossimetro, n° 1 Bilirubinometro, n° 1 centrifuga per microcapillari;

Considerato che trattasi di apparecchiatura sanitaria sottoposta ai vincoli di legge sulle verifiche periodiche, ovvero alla regolarità/conformità ai parametri di funzionalità imposti dalle case costruttrici, la cui modificazione/alterazione può procurare danni diretti/indiretti all'utente/paziente;

Atteso che il Sig. Maricca Giovanni, addetto al settore manutentivo, che sottoscrive la presente per conferma, ha adempiuto agli adempimenti di rito, individuando la Ditta manutentrice, indicata dalla Ditta costruttrice/fornitrice, nella Ditta Bertocchi S.r.l. Elettromedicali;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono ai presupposti di unicità dell'intervento, che solo una Ditta può garantire con certezza di competenza, riscontri originali e mantenimento delle garanzie del costruttore e, quindi, di efficienza e funzionalità, per cui può invocarsi il disposto dell'art. 7 p.2 lett.b del D.Lgv. 157/95, anche per non interrompere il servizio pubblico e l'assistenza;

Tenuto conto che, la Ditta costruttrice/ manutentrice ha provveduto a fornirci un preventivo gratuito e dettagliato dell'intervento tecnico, e che lo stesso è stato considerato congruo dal Primario dell'Unità Operativa esprimendo per iscritto il suo parere favorevole;

Per quanto sopra, se gli Organi Aziendali condividono le motivazioni anzidette si propone il presente affidamento.



IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI

G. Aguilà

SETT/ E:ARCA

ADD/G.MARICCA

Agui

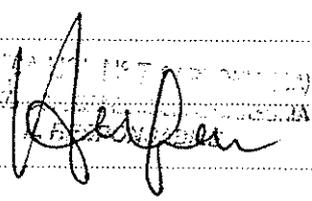
Richiesta n° del **- 4 GIU. 2001**
Reparto **PEDIATRIA**
Presidio **SILA**
Comune **CARBONIA**
Distretto

Al Servizio Acquisti
Ufficio Ass.za Apparecchiature
distr. di **CARBONIA**


OGGETTO: RICHIESTA DI INTERVENTO MANUTENTIVO

Pregasi provvedere al ripristino dell'apparecchiatura
marca **BEATO CCHI**, mod **N°2 INCUBATOREI,**
N°2 CULLE TERMOSTATICHE,
n° matr., n° inv., altri dati **N°3 FOTOPERAPIE**
N°1 OSSIMETRO
Anomalie rilevate: **N°1 PATILIRUBRIMETRO**
N°1 CENTRIFUGA

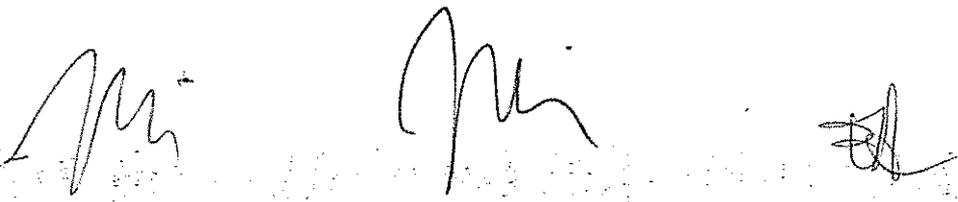
Note eventuali: **Adeguamento alle normative C.E.**



Recapito telef. reparto, Sanitario inc.to

Il Resp. del Reparto o suo Delegato


Pervenuta al Serv. Acquisti il



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA -

PROT. N° _____

Al Primario del reparto pediatria
P.O. Sirai - Carbonia
Dr. Verrecchi

OGGETTO: proposte per l'eventuale adeguamento di apparecchiature diverse, Ditta Bertocchi, alle norme C.E.I.

Con la presente si chiede cortesemente alla S.V. di esprimere un parere sulla proposta (allegata alla presente) effettuata dalla Ditta Bertocchi per la messa a norma delle loro apparecchiature presenti nel reparto di pediatria del P.O. Sirai di Carbonia.

Distinti saluti

Il Responsabile Servizio Acquisti
Gen. G. Agulii

SETT./E.Arca

ADD./G. Marica

[Handwritten signature]

S: ESPRESSO PARERE FAVOROSO CON

[Handwritten signatures]

DR. BERTOCCHI

0335-294348

-16/ 4/01

0335-8475148 Pecoli

Bertocchi Srl Elettromedical

Cremona, 02 gennaio 2001

Sip. Cobu U.T.
0381/6683231

Preg.mo Geom. Agulli
— DIRETTORE UFF. ACQUISIZIONE BENI
AZIENDA USL N. 7
CARBONIA (CA)

→ Per conoscenza: Dr. Verrocchi
Primario Pediatra

Dopo un sopralluogo presso il Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Carbonia, con la presente siamo ad informarLa nel modo più chiaro e speriamo completo, in merito alla rispondenza alle normative vigenti delle apparecchiature di nostra fornitura (produzione e rivendita) installate presso questo reparto.

La presente integra e supera la nostra n. 287bis/99 del 05.10.1999.

Ci siamo permessi di formulare una proposta con preventivo di spesa per l'eventuale adeguamento delle apparecchiature obsolete e non a norme, a quelle moderne, in produzione e rispondenti alle norme CE.

Lo stesso sarà fatto in merito ai due Enti Ospedalieri di Iglesias: S.Barbara e Fratelli Crobu.

Resta inteso che gli adeguamenti proposti avranno carattere di ripristino a nuovo con conseguente garanzia di 18 mesi; abbiamo comunque voluto allegare anche il contratto di manutenzione periodica che, indipendentemente dalla garanzia, Vi permette di lavorare con tutte le apparecchiature al massimo dell'efficienza.

Apparecchiature installate presso il Reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Carbonia:

- N. 2 Incubatrici mod. 35, matr. 9454/92 e 9417/92
- N. 2 Culle termostatiche mod. 52, matr. 8818/92 e 8819/92
- N. 3 Fototerapie mod. BSBO/8, matr. 2040/76, 2893/79 e 7488/90
- N. 1 Ossimetro mod. BSBO/2, matr. 5191/83
- N. 1 Bilirubinometro WAKO mod. SE 101 D, matr. 7753
- N. 1 Centrifuga per microcapillari mod. 4203, matr. 36-0315

Le incubatrici mod. 35 non sono rispondenti al seguente articolo delle norme C.E.I. 62-22 "Norme particolari per la sicurezza delle incubatrici per bambini", seconda edizione novembre 1992:

- art. 6.1.101. Una incubatrice non equipaggiata con un analizzatore di ossigeno incorporato e dotata di mezzi per la somministrazione di ossigeno deve essere marcata in un punto visibile dell'apparecchio, con un testo che riporta "Usare un analizzatore di ossigeno quando si somministra ossigeno".

Inoltre non sono conformi a quanto prescritto nella direttiva 89/336/CEE, sulla compatibilità elettromagnetica e nella direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici.

Le 2 culle termostatiche mod. GB 52 non corrispondono a quanto prescritto nella direttiva 89/336/CEE e nella direttiva 93/42/CEE. Inoltre non possono più essere utilizzate con la campana in plexiglass posizionata sopra il vano paziente.

Cassa Registro: Via Canale Montebello, 41 • 26100 CREMONA • Cap. Soc. 20.000.000 I.V. • ISCR. C.C.I.A.A. CR 37/42097 • I.L.E.A. 116291/CH • P. IVA 01145580195

I 3 apparecchi per fototerapia mod. BSBO/8 non corrispondono a quanto indicato nelle norme C.E.I. 62-5 del gennaio 1991 per i seguenti motivi:

- art. 57.1. manca l'interruttore doppio (dispositivo per separare dalla rete di alimentazione tutti e due i poli contemporaneamente);
- art. 42.1. manca la protezione contro il surriscaldamento della parte superiore;
- art. 24.3. manca la protezione contro il ribaltamento.

Inoltre non sono conformi a quanto prescritto nella direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica e nella direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici.

L'ossimetro mod. BSBO/2 non corrisponde a quanto indicato nelle norme C.E.I. 62-5 del gennaio 1991 per i seguenti motivi:

art. 57.1. manca l'interruttore doppio (dispositivo per separare dalla rete di alimentazione tutti e due i poli contemporaneamente);

art. 57.6. manca il fusibile su ogni polo di alimentazione.

Inoltre non è conforme a quanto prescritto nella direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica e nella direttiva 93/42/CEE.

Il bilirubinometro mod. Wako non corrisponde a quanto indicato nelle norme C.E.I. 62-5 del gennaio 1991 per i seguenti motivi:

• art. 57.1. manca l'interruttore doppio (dispositivo per separare dalla rete di alimentazione tutti e due i poli contemporaneamente);

• art. 57.6. manca il fusibile su ogni polo di alimentazione.

Inoltre non è conforme a quanto prescritto nella direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica e nella direttiva 93/42/CEE.

La centrifuga mod. 4223 non corrisponde a quanto indicato nelle norme C.E.I. 62-5 del gennaio 1991 per i seguenti motivi:

• art. 57.6. manca il fusibile su ogni polo di alimentazione.

Inoltre non è conforme a quanto prescritto nella direttiva 89/336/CEE e nella direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici.

OFFERTA N. 07/01

Proposta di messa a norme:

INCUBATRICI MOD. 35

Si tratta di intervenire sulla componentistica elettrica ed elettronica e sulla struttura meccanica in modo da portare le apparecchiature ad assumere le caratteristiche tecniche ed estetiche del tutto simili all'incubatrice

- mod. GB35BRO. L'importo dell'intervento franco Vostro ente, senza alcun onere aggiuntivo, è di L. 10.500.000, cadauna (il prezzo dell'incubatrice nuova è di L. 20.300.000).
- mod. GB35RO, modello più performante. L'importo dell'intervento, franco Vostro ente, senza alcun onere aggiuntivo, è di L. 14.000.000 (il prezzo dell'incubatrice nuova è di L. 24.000.000).
- mod. New Age Primary Care. L'importo dell'intervento, franco Vostro ente, senza alcun onere aggiuntivo, è di L. 12.500.000 (il prezzo dell'incubatrice nuova è di L. 21.000.000).
- mod. New Age Special Care, più performante rispetto alla Primary Care. L'importo dell'intervento, franco Vostro ente, senza alcun onere aggiuntivo, è di L. 16.000.000 (il prezzo dell'incubatrice nuova è di L. 25.800.000).

CULLE TERMOSTATICHE MOD. GB 52

Si tratta di intervenire sulla componentistica elettrica, elettronica in modo da portare l'apparecchiatura ad assumere le caratteristiche tecniche ed estetiche del tutto simili al nuovo modello GB 52.

L'importo dell'intervento franco Vostro ente, senza alcun onere aggiuntivo, è di L. 6.200.000, cadauna (l'importo della culla termostatica mod. GB 52 nuova è di L. 9.950.000).

APPARECCHI PER FOTOTERAPIA MOD. BSBO/8

Si tratta di intervenire sulla componentistica elettrica, elettronica e sulla struttura meccanica in modo da portare l'apparecchiatura ad assumere le caratteristiche tecniche ed estetiche del tutto simili al mod. GB57. L'importo dell'intervento franco Vostro ente, senza alcun onere aggiuntivo, è di L. 3.000.000, cadauno (il prezzo dell'apparecchio per fototerapia mod. GB 57 nuovo è di L. 6.000.000).

OSSIMETRO MOD. BSBO/2

Si tratta di intervenire sulla componentistica elettrica, elettronica e sulla struttura meccanica in modo da portare l'apparecchiatura ad assumere le caratteristiche tecniche ed estetiche del tutto simili al mod. TED 200-T.

L'importo dell'intervento franco Vostro ente, senza alcun onere aggiuntivo, è di L. 1.900.000 (il prezzo dell'analizzatore di ossigeno mod. TED 200-T nuovo è di L. 3.200.000).

BILIRUBINOMETRI WAKO

Si tratta di intervenire sulla componentistica elettrica, elettronica e sulla struttura meccanica in modo da portare l'apparecchiatura ad assumere le caratteristiche tecniche ed estetiche del tutto simili al mod. GB 13/A.

L'importo dell'intervento franco Vostro ente, senza alcun onere aggiuntivo, è di L. 4.800.000 (il prezzo del bilirubinometro mod. GB 13A nuovo è di L. 7.900.000).

CENTRIFUGA MOD. 4223

Si tratta di intervenire sulla componentistica elettrica, elettronica e sulla struttura meccanica in modo da portare l'apparecchiatura ad assumere le caratteristiche tecniche ed estetiche del tutto simili al nuovo modello di centrifuga MIKRO 20.

L'importo dell'intervento franco Vostro ente, senza alcun onere aggiuntivo, è di L. 2.500.000 (il prezzo della centrifuga MIKRO 20 nuova è di L. 3.800.000).

CONDIZIONI:

TEMPO TECNICO PER L'ADEGUAMENTO: entro e non oltre 60 gg. lavorativi dall'ordine, in particolare per le incubatrici della serie New Age, 120 giorni dall'ordine

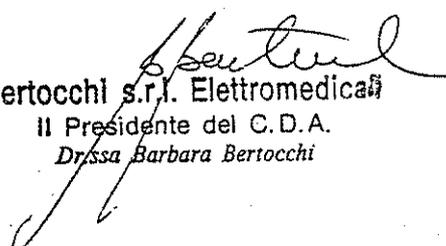
TRASPORTO, IMBALLO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO: a nostro carico.

PAGAMENTO: entro e non oltre 90 giorni data fattura.

I.V.A. 20%: esclusa, a Vs. carico.

GARANZIA: 18 mesi. 12 mesi sulla centrifuga.

VALIDITA' OFFERTA: 30 giorni


Bertocchi s.r.l. Elettromedicali

Il Presidente del C.D.A.

Dr.ssa Barbara Bertocchi