

Deliberazione n° 467adottata da Direttore Generale in data 8 MAG. 2009

Oggetto: *Procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di n° 1 Autoclave a vapore per il Blocco operatorio del PO CTO.
Ratifica atti di gara. Aggiudicazione in favore della Ditta CISA.*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

- Vista** la Delibera n° 195 del 25.02.2009, con la quale l'Azienda ha autorizzato la procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per l'affidamento della fornitura urgente di n°1 Autoclave a vapore per il Blocco operatorio del PO CTO, approvando contestualmente la lettera d'invito;
- Atteso** che:
- in esecuzione del succitato atto, l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato con Racc. RR Prot. 4053 del 27.02.2009 alle sotto elencate ditte, prevedendo il termine per la presentazione delle offerte al giorno 23.03.2009;
DE LAMA (Pavia) – Sordina (Padova) – STERIL (Lecce) – CISA (Pomezia) – Temosa (Sassari) – Getinge (Roma);
 - con nota fax Prot. 5693 del 18.03.2009, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di ditta concorrente, il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 13,00 del 06.04.2009;
 - entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle sottotelencate Ditte:
Sordina – CISA – Getinge;
- Visti** i verbali di gara in data 09.04.2009, 15.04.2009 e 23.04.2009 della Commissione di aggiudicazione, nominata con Disposizione Amministrativa n° 10 del 07.04.2009;
- Preso atto** che la Commissione ha proposto l'aggiudicazione in favore della Ditta CISA che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Vista** la lettera d'invito;
- Ravvisata** la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;

Propone

- di disporre l'aggiudicazione della gara mediante procedura negoziata per la fornitura urgente di n° 1 Autoclave a vapore per il Blocco operatorio del PO CTO, così come si evince dai verbali della Commissione di aggiudicazione in data 09.04.2009, 15.04.2009 e 23.04.2009, allegati al presente atto per costituirne parte integrante;

Il Direttore Generale

- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;
- Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di ratificare gli allegati verbali in data 09.04.2009, 15.04.2009 e 23.04.2009 della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata per la "fornitura urgente di n° 1 Autoclave a vapore per il Blocco operatorio del PO CTO, autorizzata con Delibera n° 195 del 25.02.2009;
- ▶ di disporre l'aggiudicazione così come riportato nel prospetto allegato, costituito da n° 1 pagina e parte integrante della presente delibera;
- ▶ di rinviare a successivo ed apposito atto l'eventuale affidamento relativo al contratto quinquennale del servizio di manutenzione full-risk post garanzia;
- ▶ di dare atto che il presente affidamento è soggetto a stipula contrattuale;
- ▶ di disporre l'affidamento provvisorio nelle more di predisposizione del relativo contratto;
- ▶ di demandare al capo servizio bilancio/contabilità di provvedere all'emissione di regolare fattura di addebito a carico della Ditta CISA per la somma di € 2.000,00 + IVA 20% per la permuta dell'apparecchiatura in dotazione al blocco operatorio del PO CTO, e nello specifico:
 - **n° 1 Autoclave sterilizzatrice marca DE LAMA modello DLOH inv. N. 19744**
- ▶ di procedere alla cancellazione dal libro dell'inventario della succitata apparecchiatura;
- ▶ di disporre che la somma di € 2.400,00 relativa alla permuta della succitata apparecchiatura, sia utilizzata per l'acquisizione dell'apparecchiatura oggetto del presente atto;
- ▶ di procedere alla cancellazione dal libro dell'inventario dell'**Autoclave sterilizzatrice marca DE LAMA modello DLOH inv. N. 19744;**
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di imputare la spesa complessiva di € 53.100,00 IVA 20% inclusa, sulla classe di costo 020300004 del piano dei conti aziendale come segue:

€ 50.700,00 sul bilancio corrente;
€ 2.400,00 sulla somma di pari importo, relativa alla permuta dell'**Autoclave sterilizzatrice marca DE LAMA modello DLOH inv. N. 19744;**

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/FODDIS

Coll. Amm.vo/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Pietro Pasquale Chessa

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione
n° 404 del 8 MAG. 2009

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7 6. 2009
a partire dal 8 MAG. 2009 al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

[Handwritten signature]

Destinatari:

*Collegio dei sindaci
Servizio Acquisti
Servizio Bilancio
Ufficio ordini/magazzino economale
Ufficio Collaudi*

Prospetto aggiudicazione

Ditta CISA Spa (offerta n° 27192 del 18.03.2009)
 Via Pontina Km 28 - 00040 Pomezia (RM) _ Tel. 06.911437.1 Fax. 06.9107565
 P.IVA 03531371007

Descrizione	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
Lotto Unico - CIG [0280985427]					
Autoclave orizzontale di sterilizzazione a vapore CISA mod. 6412H/1P/EVTSISV completa di:		1			
Apparato d'interfaccia CISA, mod. E-BOX, microprocessore industriale per il collegamento dell'autoclave a sistemi esterni di rintracciabilità, di registrazione, di manutenzione da remoto		1			
Compressore silenziato con funzionamento a secco WERTHER, mod. CMCS0/6		1			
Addoccatore automatico cabinato a Sali NOBEL, mod. AC150/A completo di prefiltro FCR	€ 36.100,00	1	€ 36.100,00	€ 7.220,00	€
Carrello interno CISA per autoclave 6412, per il carico in camera di sterilizzazione di cestelli e vassoi, capacità di carico 8 U.S.		1			
Carrello esterno ad altezza variabile CISA per la movimentazione del carrello interno		1			
Lavori di adeguamento del sito di installazione agli ingombri dell'autoclave, di posizionamento ed installazione della macchina, di rifinitura dell'apparecchiatura con cornice e pannelli in acciaio completi di telaio e supporto		1			
Esecuzione di prove statiche sulla struttura del solaio, progettazione (a timbro e firma di tecnico abilitato) ed esecuzione dei lavori di posizionamento di zoccolatura in acciaio inox al di sotto dell'apparecchiatura per la ripartizione del peso della stessa fino ad ottenere un valore tollerabile di spinta sul pavimento	€ 8.150,00	1	€ 8.150,00	€ 1.630,00	€ 9.780,00
Totale "chiavi in mano"			€ 44.250,00	€ 8.850,00	€ 53.100,00
Permuta n° 1 Autoclave sterilizzatrice marca DE LAMA modello DLOH inv. N. 19744, comprensiva di disinstallazione e smaltimento in base alla normativa vigente			€ 2.000,00	€ 400,00	€ 2.400,00

Oggetto: Verbale della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura urgente di n° 1 autoclave a vapore per il blocco operatorio del PO CTO.

Addì 09 del mese di aprile dell'anno 2009 alle ore 9.00, nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata, previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione individuata con Disposizione Amministrativa n° 10 del 07.04.2009, presieduta dalla Dr.ssa Agnese Foddis e composta come segue:

Ing. Brunello Vacca	Componente
Geom. Luigi Ventura	Componente
Sig.ra Alessandra Ventura	Segretario

per decidere in merito all'aggiudicazione della fornitura urgente di n° 1 autoclave per il blocco operatorio del PO CTO, disposta mediante procedura negoziata ad offerte plurime (cottomo fiduciario) in esecuzione della Delibera n° 195 del 25.02.2009.

Premesso che:

- l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato a mezzo Servizio Postale con RR Prot. 4053 del 27.02.2009 alle sotto elencate ditte: DE LAMA (Pavia) – Sordina (Padova) – STERIL (Lecce) – CISA (Pomezia) – Temosa (Sassari) – Getinge (Roma), con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 23.03.2009.
- a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di concorrente, con nota fax Prot. 5693 del 18.03.2009, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del 06.04.2009;

La Commissione prende atto che:

- entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle sottotelencate Ditte:

CISA Prot. 7033 del 06.04.2009



O kelwe

Getinge Prot. 5827 del 20.03.2009

Sordina Prot. 6933 del 03.04.2009

- la Ditta DELAMA ha motivatamente declinato l'invito con nota Prot. ASL 4976 del 10.03.2009;

La Commissione, previa verifica delle condizioni di gara, procede al controllo della documentazione prodotta dalle Ditte. La documentazione è conforme e pertanto tutte le ditte vengono ammesse alle fasi successive di gara.

La Commissione procede all'esame delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti tenendo conto e confrontando la tecnologia e qualità costruttiva, nonché valutando le migliorie rispetto alle caratteristiche minimali richieste.

La Commissione procede in particolare all'esame del prodotto proposto dalla Ditta Getinge.


Alle ore 12,00 il Presidente aggiorna la seduta alle ore 9,00 del 15.04.2009.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE



LA COMMISSIONE

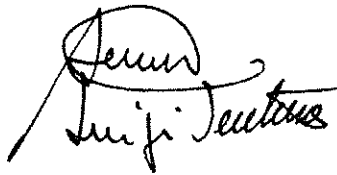

IL SEGRETARIO



Oggetto: *Verbale della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura urgente di n° 1 autoclave a vapore per il blocco operatorio del PO CTO.*

Addì 15 del mese di aprile dell'anno 2009 alle ore 9.00, nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata, previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione, presieduta dalla Dr.ssa Agnese Foddis e composta dall'Ing. Brunello Vacca, dal Geom. Luigi Ventura e dalla Sig.ra Alessandra Ventura con funzioni di segretario verbalizzante per la continuazione dei lavori di valutazione tecnico qualitativa dei singoli prodotti offerti e all'attribuzione del relativo punteggio, a seguito della precedente seduta di valutazione tenutesi in data 09.04.2009, per la quale è stato redatto apposito verbale.

La Commissione procede all'esame delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalle Ditte CISA e Sordina.

Dopo attenta analisi, la Commissione è pervenuta alle conclusioni risultanti dal prospetto comparativo allegato, costituito da n° 4 pagine e parti integranti del presente verbale.

Nel prospetto sono stati indicati per ciascun lotto le ditte offerenti, i modelli delle apparecchiature proposte, la valutazione della commissione, nonché i punteggi qualità attribuiti sulla base dei parametri individuati al punto H) della lettera d'invito e nello specifico:

- | | |
|--|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Caratteristiche tecniche generali
Dimensioni e peso, struttura portante, circuiti di alimentazione (elettrica, idrica, vapore, etc...), circuiti di sicurezza | Punti 20/100 |
| <ul style="list-style-type: none">• Camera di sterilizzazione
Dimensioni, struttura, realizzazione porta, coibentazione, etc... | Punti 10/100 |



• **Sistema di controllo e documentazione**

Punti 10/100

Numero di cicli preimpostati,
programmabili e di autodiagnosi,
sistema di stampa, display, tastiera,
dispositivi di sicurezza, etc...

• **Accessori**

- Carrello di carico e scarico cestelli / vassoi (2 pt)
- Sistema addolcitore acqua di rete per generatore dedicato (6 pt)

Punti 8/100

• **Opzioni offerte e possibilità di espansione del sistema (up-grade)**

Punti 2/100


Il Presidente aggiorna la seduta in data da destinarsi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



LA COMMISSIONE

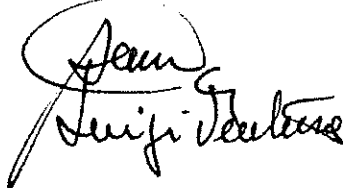




IL SEGRETARIO



Prospetto comparativo
Procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di n° 1 autoclave per il Blocco operatorio del PO CTO

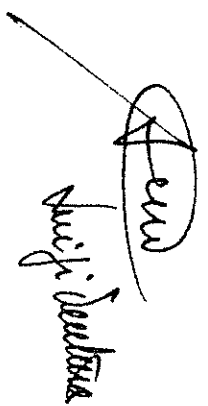Lotto unico - Autoclave a vapore saturo - CIG [0280985427] - segue		Q.tà	Ditta Galinge	Ditta CISA	Ditta Sordina
Caratteristiche indicate in Capitolato Il software del sistema di controllo deve essere documentato e validato conformemente alle normative applicabili ed ai più recenti standard di qualità. L'autoclave deve essere dotata di dispositivi di sicurezza che evitano: - l'inizio del programma se la porta non è perfettamente chiusa - l'inizio del riscaldamento se manca acqua nel generatore di vapore (vapore autoprodotta) - l'innalzamento della pressione nel generatore, nell'intercapedine e in camera oltre il valore di esercizio - il passaggio alla fase successiva di un programma se i parametri operativi della fase precedente non hanno avuto uno sviluppo regolare - l'apertura della porta con la camera in pressione L'autoclave deve essere dotata di: - predisposizione per il collegamento ad un sistema di registrazione e documentazione elettronica esterna (stampante e/o memory card) - predisposizione per il collegamento informatico ad un Supporto Tecnico Remoto della Casa Madre - predisposizione per il collegamento ad una rete Ethernet per la gestione e la supervisione in loco dei parametri		SI	SI non si evince SI no si evince SI	SI non si evince SI no si evince SI	SI SI SI non si evince SI
ACCESSORI 1) n° 1 carrello di carico in acciaio inox per il carico / scarico dei cestelli e vassoi 2) n° 1 sistema addolcitore per l'acqua di alimentazione al generatore di vapore dedicato			SI SI	SI SI	SI (osmosi)
Valutazione complessiva					
Ditta Galinge		Conforme. Dimensioni e peso più contenuti rispetto alle altre ditte concorrenti. Buona la qualità costruttiva e di composizione.			
Ditta CISA		Conforme. Buona la qualità costruttiva e di composizione. Peso leggermente superiore rispetto alle altre Ditte concorrenti			
Ditta Sordina		Conforme. Buona la qualità costruttiva e di composizione. Presenta caratteristiche quali: sistema di addolcimento dell'acqua mediante un processo di osmosi - possibilità di collegamento ad un sistema di registrazione e documentazione elettronica esterna (stampante e/o memory card) - possibilità di collegamento informatico ad un Supporto Tecnico Remoto della Casa Madre - possibilità di collegamento ad una rete Ethernet per la gestione e la supervisione in loco dei parametri			

Lotto unico - Autoclave a vapore saturo - CIG [0280985427] - segue

Caratteristiche indicate in Capitolato

La Ditta partecipante deve indicare i seguenti dati di tarpa della macchina:

	Q1A	Ditta Geringe	Ditta CISA	Ditta Sordina
Peso complessivo (Kg)		Kg. 970	Kg. 1250	Kg. 1170
- Pressione sul pavimento (Kg/m ²)		Kg. 280/mq	Kg. 380/mq	Kg. 910/mq
Alimentazione elettrica				
- Tensione di alimentazione [V]		380 V	400 V3 +N+T	400 V3 +N+T
- Potenza assorbita (senza generatore dedicato) [KW]		3KW	4KW	55KW
- Potenza assorbita (con generatore dedicato) [KW]		33KW	31KW	
Alimentazione idrica				
- Pressione [bar]		3/6 bar	0,5/3 bar	2-3 bar
- Portata [m ³ / h]		2,5 mch	0,3 mch (15Nl. Min)	1,5 H. min.
- Durezza acqua [° f]		< 7°F	0°F	0,5°F
Alimentazione vapore				
- Pressione [bar]		2,5/3 bar	3/3,65 bar	2-3 bar
- Portata [m ³ / h]		120 Kg/h	60 Kg/h	110 Kg/h
Alimentazione aria				
- Pressione [bar]		6/8 bar	6/8 bar	5/7 bar
- Portata [m ³ / h]		3N mch	0,9N mch (15N lt. Min)	200 l/h/h
CAMERA DI STERILIZZAZIONE				
Capacità della camera : 8 UST - Unità di Sterilizzazione (N.B. : una UST ha dimensioni 300 mm x 300 mm x 600 mm , pari a una capacità 54 litri)		8 UST L. 595	8 UST	8 UST
Sezione rettilineare della camera (Specificare misure A x L x P)		h 670 L 660 P 4300	h 660 L 660 P 1290	h 625 L 655 P 1245
Altezza del piano di caricamento della camera dal pavimento: ± 500 mm		800 mm	830 mm	1095 mm
Realizzazione della camera, porta e intercapedine in acciaio inox AISI 316		AISI 316	AISI 316 TI	AISI 316 TI
Apertura e chiusura della porta ottenuta mediante scorrimento automatico per mezzo di sistemi elettromeccanici, con sistema di protezione antischiacciamento e chiusura pneumatica a quantizione		si	si	si
Colbenazione ad alta efficienza per minimizzare il consumo di vapore, acqua, energia (indicare massima temperatura sull'involucro esterno, per evitare ustioni accidentali)		si	si	si
SISTEMA DI CONTROLLO E DOCUMENTAZIONE				
Ciclo di sterilizzazione controllato con microprocessore, con programmi produttivi predefiniti dal costruttore		si	si	si
Display grafico per la visualizzazione delle attività, dei dati e dei parametri di processo		si	si	si
Tastiera multifunzione impermeabile incorporata nel quadro comando (specificare grado IP)		si	si	si
Inserimento diretto da tastiera dei parametri di ciclo prescelti		si	si (IP 54) (IP22)	si
Stampante integrata per la produzione della documentazione relativa a tutti i dati di processo		si	si	si
Protezione dell'accesso alla programmazione dei cicli tramite password		si	si (chiave di accesso)	si
Possibilità di programmare / memorizzare cicli di lavoro in funzione del carico e del tipo di confezionamento		si	si	si
Possibilità di controllo ed audiodiagnosi di tutte le funzioni sul pannello di controllo		?	si	si
Programmi diagnostici (indicare altri programmi presenti):		si	si	si
- Test di tenuta al vuoto				
- Test di Bowie & Dick				

[Handwritten signatures and notes]

Prospetto comparativo
Procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di n° 1 autoclave per il Blocco operatorio del PO CTO


Lotto unico - Autoclave a vapore saturo - CIG [0280985427]	C/A	Ditta Gellinge	Ditta CISA	Ditta Sordina
<p>Caratteristiche Indicate in Capitolato</p> <p>Fornitura e installazione di un autoclave di sterilizzazione a vapore saturo, per il trattamento specifico di tutti i materiali utilizzati nel campo sanitario/ ospedaliero, quali indicativamente e non esaustivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carichi metallici (ferri chirurgici, strumenti per microchirurgia, strumenti dentali, etc...) - tessuti (garze, bande, camici, divise, etc...) e carichi porosi - prodotti in gomma ed in plastica autoclavabile <p>L'autoclave deve essere conforme alle normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direttiva Macchine 98/37/CE - Dispositivi Medici 93/42/CE - Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CE - Apparecchi a pressione 97/23/CE - UNI EN 285 - UNI EN 554 - UNI EN 556 - UNI EN 866 - UNI EN 867 <p>oltre alla conformità alle normative particolari in materia (UNI, CEI, ISPESI, etc...) ove non espressamente richiamate.</p> <p>Doppia alimentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vapore diretto (condizione normale) - vapore autoprodotta tramite generatore dedicato con controllo di livello (condizione d'urgenza) <p>Dimensioni massime di ingombro esterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> altezza 1800 mm <input type="checkbox"/> larghezza 1300 mm <input type="checkbox"/> profondità 1200 mm <p>Struttura portante in acciaio e pannelli di rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304 satinato</p> <p>Circolo idraulico colmatato, con tubazioni e raccordi in acciaio inox AISI 316 a tenuta di pressione e di vuoto</p> <p>Valvole pneumatiche e/o elettriche per l'intercezione dei fluidi</p> <p>Pompa per vuoto ad anello liquido per l'evacuazione dell'aria in camera e l'asciugamento del carico, protetta contro le intrusioni dirette di vapore</p> <p>Intermittente generale a chiave e pulsante "a fungo" di sicurezza</p> <p>Dotata di strumenti analogici e/o digitali per l'indicazione e la registrazione dei valori di pressione, vuoto e temperatura all'interno della camera e nell'intercapedine</p>	1	HS 6613 ER1	6412H/PIE/VT/SV	A6612EV
		si	si	si
		1980 900 1656	1850 1250 1546	1800 1380 1450 + 200
		AISI 316	AISI 304	AISI 304
		si	si	si
		si	si	si
		si	si	si
		si	si	si
		si	si	si

[Handwritten signatures and notes]

Luigi Venturoli

Chelune

Punteggio qualità	50/100	Ditta Getinge	Ditta CISA	Ditta Sordina
Caratteristiche tecniche generali Dimensioni e peso, struttura portante, circuiti di alimentazione (elettrica, idrica, vapore, etc...), circuiti di sicurezza	20	20	18	19
Camera di sterilizzazione Dimensioni, struttura, realizzazione porta, colpendazione, etc...	10	10	10	10
Sistema di controllo e documentazione	10	8	8	10
Numero di cicli preimpostati, programmabili e di autodiagnosi, sistema di stampa, display, tastiera, dispositivi di sicurezza, etc				
Accessori				
- Carrello di carico e scarico cestelli / vassoi (2 pt)	8	2	2	2
- Sistema addolcitore acqua di rete per generatore dedicato (6 pt)	4	4	4	6
Opzioni offerte e possibilità di espansione del sistema (up-grade)	2	0	0	0
Totale punteggio qualità		44	42	47

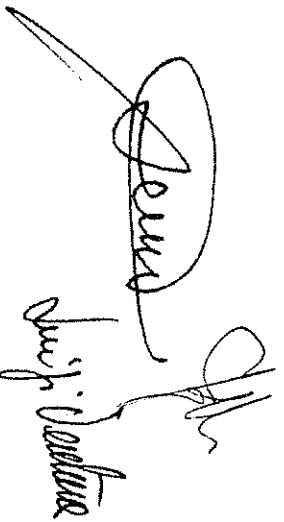

 Luigi Ventura

01/07/2012

Oggetto: *Verbale della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura urgente di n° 1 autoclave a vapore per il blocco operatorio del PO CTO.*

Addì 23 del mese di aprile dell'anno 2009 alle ore 9.45, nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata, previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione, presieduta dalla Dr.ssa Agnese Foddis e composta dall'Ing. Brunello Vacca, dal Geom. Luigi Ventura e dalla Sig.ra Alessandra Ventura con funzioni di segretario verbalizzante per la continuazione dei lavori di valutazione tecnico qualitativa dei singoli prodotti offerti e all'attribuzione del relativo punteggio, a seguito delle precedenti sedute di valutazione tenutesi in data 09.04.2009 e 15.04.2009, per le quali è stato redatto apposito verbale.

La Commissione procede all'apertura delle offerte economiche e constata quanto riportato nel prospetto prezzi allegato, costituito da n° 1 pagina e parte integrante del presente verbale.

Considerando i prezzi riportati nell'allegato prospetto prezzi, la Commissione procede all'attribuzione del punteggio per il prezzo secondo quanto disposto al punto H) della lettera d'invito.


Il punteggio complessivo ottenuto, punteggio qualità sommato al punteggio prezzo, risulta dal medesimo prospetto prezzi allegato.

Sulla base dei punteggi complessivi ottenuti la Commissione propone l'aggiudicazione in favore della Ditta CISA.


Letto, confermato e sottoscritto.

Alle ore 10.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.


IL PRESIDENTE



LA COMMISSIONE

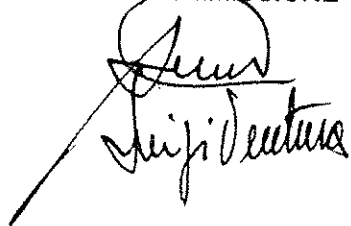

IL SEGRETARIO



Prospetto prezzi
 Procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di n°1 Autoclave per il Blocco operatorio del PO CTO

Lotto	Descrizione	Q.tà	Ditta Gellinge	Ditta CISA	Ditta Sordina
Unico	Autoclave a vapore saturo - CIG [0280985427]	1	HS 613 ER1	6412H/1PIEV/TS/SV	A6612EV
	Prezzo	€	43.268,00 €	44.250,00 €	47.413,65
	Prezzo contratto quinquennale manutenzione	€	16.250,00 €	10.200,00 €	11.860,70
	Permessa	€	4.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00
	Totale prezzo	€	55.518,00 €	52.450,00 €	58.294,35
	Punteggio qualità		44,00	42,00	47,00
	Punteggio prezzo		47,24	50,00	44,99
	Totale punteggio		91,24	92,00	91,99

C. Pell

Deus
Luigi De Santis

Q. Velino