



13 NOV 2013

Deliberazione n. 1886

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: Smarrimento dell'apparecchiatura Polisonnografo Embla mod. Titanium matr. EPS-0155/01-8 inv. 26231. Accettazione proposta di consegna di n. 3 polisonnografi Embla mod. EMBLETTA MPR PG XS, a titolo di risarcimento da parte della Ditta Sapio Life s.r.l.
Ditta Sapio Life s.r.l.

Il Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

PREMESSO

- che in data 17.02.2012, l'ASL 7 Carbonia inoltrava alla Ditta Sapio Life s.r.l. una richiesta di riparazione del Polisonnografo Embla mod. Titanium matr. EPS-0155/01-8 inv. 26231 in dotazione all'U.O. di Pneumologia del P.O. S. Barbara di Iglesias;
- che in data 27/03/2012, la Sapio Life s.r.l. riceveva tale Polisonnografo nel proprio magazzino di Porto Torres e da qui lo inviava al proprio centro di assistenza tecnica di Vapro d'Adda (MI), che, constatando l'impossibilità di riparazione in loco, disponeva l'invio del Polisonnografo presso il centro di assistenza del produttore Embla in Inghilterra;

PRESO ATTO

che la Ditta Sapio Life S.r.l., con nota del 12.09.2013, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ha comunicato all'ASL 7 Carbonia che l'apparecchiatura in oggetto, inviata per la riparazione presso il produttore Embla in Inghilterra, è stata smarrita dalla stessa Embla;

CONSIDERATO

che la Ditta Sapio Life S.r.l., quale rappresentante e distributore esclusivo Embla in Italia, a fronte del danno arrecato all'Azienda, ha comunicato nella stessa nota del 12.09.2013 che, a titolo di risarcimento è disponibile a proporre la consegna, direttamente all'U.O. di Pneumologia del P.O. S. Barbara di Iglesias, n. 3 polisonnografi di nuova generazione, mod. EMBLETTA MPR PG XS;

DATO ATTO

che, dai dati disponibili ad inventario, il Polisonnografo Embla mod. Titanium matr. EPS-0155/01-8 inv. 26231 dell'ASL 7 Carbonia, è stato acquisito il 23/09/2008 con una spesa di acquisto di € 19.200,00 iva al 20% compresa;

ACCERTATO

nell'ambito dei riscontri operati dall'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica:

- che il valore commerciale dei n. 3 polisonnografi di nuova generazione, mod. EMBLETTA MPR PG XS, è indicato pari ad € 6.500,00 + iva cadauno,
- che altre aziende del SSN hanno acquisito tecnologia paragonabile a quella proposta a titolo di risarcimento ad un costo rapportabile a quello indicato nella nota della Sapio Life S.r.l. del 12/09/2013,
- che la spesa complessiva d'acquisto del Polisonnografo Embla mod. Titanium matr. EPS-0155/01-8 inv. 26231 sostenuta nel 2008 è stato pari a € 19.200,00 iva al 20% compresa,
- che il costo di € 19.200,00 di cui sopra, previamente decurtato delle quote di ammortamento e fatti i dovuti raffronti tecnologici che portano alla conclusione di una idoneità del prodotto EMBLETTA MPR PG XS rispetto ai bisogni dell'U.O. di Pneumologia;

CONSIDERATO

che la proposta risarcitoria della Sapio Life S.r.l. di cui alla nota del 12.09.2013, è condivisa, quanto ad aspetti clinici, anche dal Resp.le dell'U.O. di Pneumologia del P.O. S. Barbara di Iglesias Dr. Pietro Greco,

RITENUTO

che sulla base delle motivazioni e necessità su esposte, la proposta di risarcimento formulata dalla ditta Sapio Life s.r.l. può dichiararsi appropriata per la ASL 7 Carbonia;

PROSPETTANDO

la cancellazione dall'inventario e dal registro dei cespiti Aziendale, l'apparecchiatura Polisonnografo Embla mod. titanium matr. EPS-0155/01-8 inv. 26231 andata smarrita dalla Ditta Sapio Life S.r.l., quale rappresentante e distributore esclusivo Embla in Italia, e, per le ragioni di cui sopra, l'autorizzazione al collaudo tecnico/amministrativo per l'acquisizione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

delle nuove tecnologie (n. 3 polisonnografi di nuova generazione, mod. EMBLETTA MPR PG XS);

PRESO ATTO

che la Ditta Sapio Life S.r.l, con nota del 15.10.2013, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ha comunicato all'ASL 7 Carbonia che, in accordo con il dott. Pietro Greco responsabile dell'U.O. di Pneumologia del P.O. S. Barbara di Iglesias, di aver operato una consegna anticipata, svincolata da ogni obbligo di acquisizione, dei n. 3 polisonnografi di nuova generazione, mod. EMBLETTA MPR PG XS, di valore commerciale pari ad € 6.500,00 + iva cadauno;

PROPONE

per quanto sopra esposto:

- di accettare con il presente atto, a fronte del danno arrecato all'Azienda ASL n. 7 Carbonia, la proposta risarcitoria della Ditta Sapio Life s.r.l., consistente nella consegna di n. 3 polisonnografi di nuova generazione, mod.EMBLETTA MPR PG XS, per un valore complessivo pari o superiore al valore dell'apparecchiatura smarrita Polisonnografo Embla mod. Titanium matr. EPS-0155/01-8 inv. 26231, andato smarrito;
- di assegnare la nuova tecnologia, n° 3 mod. EMBLETTA MPR PG XS, all'U.O. di Pneumologia del P.O. S. Barbara di Iglesias;
- di autorizzare la cancellazione dall'inventario e dal registro dei cespiti Aziendale, l'apparecchiatura Polisonnografo Embla mod. Titanium matr. EPS-0155/01-8 inv. 26231 andata smarrita dalla Ditta Sapio Life S.r.l.;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO

dell'istruttoria del Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica;

SENTITI

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- di accettare con il presente atto, a fronte del danno arrecato all'Azienda ASL n. 7 Carbonia, la proposta risarcitoria della Ditta Sapio Life s.r.l., consistente nella consegna di n. 3 polisonnografi di nuova generazione, mod. EMBLETTA MPR PG XS, per un valore complessivo pari o superiore al valore dell'apparecchiatura smarrita Polisonnografo Embla mod. Titanium matr. EPS-0155/01-8 inv. 26231, da assegnare all'U.O. di Pneumologia del P.O. S. Barbara di Iglesias;
- di assegnare la nuova tecnologia, n° 3 mod. EMBLETTA MPR PG XS, all'U.O. di Pneumologia del P.O. S. Barbara di Iglesias;
- di autorizzare la cancellazione dall'inventario e dal registro dei cespiti l'apparecchiatura Polisonnografo Embla mod. titanium matr. EPS-0155/01-8 inv. 26231;
- di demandare al Responsabile dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica ciascuno per le proprie competenza, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti al presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Maurizio Calamita

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Claudio Ferri

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Andrea Corrias

Resp.le I.C. Ing. C. Cocco

Dott. F. Marini





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Deliberazione

n° 1886 del 13 NOV 2013

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Azienda

USL n° 7 a partire

dal 14 NOV. 2013 al 28 NOV. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio Affari Generali




Carveta

allegati n. 02

Destinatari:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Ufficio di Ingegneria Clinica Aziendale
- Servizio Acquisti
- Direzione Medica PP.OO. Iglesias
- U.O. di Pneumologia P.O. S.Barbara Iglesias



ANTICIPATA A MEZZO FAX AL N° 0781/3922605

Tot. PAG. 3

All. 01

Spett.le
ASL 7 Carbonia
Via Dalmazia, 83
09013 CarboniaAlla c.a Ing. Cristian Cocco
Responsabile Ingegneria ClinicaE p.c. Dott. Pietro Greco
Responsabile Pneumologia Iglesias

ASL 7 Carbonia

25 SET 2013

Monza, 12 settembre 2013

OGGETTO: Smarrimento polisonnografo modello TITANIUM EPS-0155/01-08

Spett.le ASL, Egregi Dott.ri

con la presente Sapio Life vi comunica che il polisonnografo di cui in oggetto di vostra proprietà è stato smarrito durante la riparazione presso il sito del produttore Embla, ad opera di Embla stessa come da e-mail inviateci dal produttore e che si allegano.

Di seguito, riassumiamo brevemente quanto accaduto:

- In data 27/03/2012 il magazzino della filiale Sapio Life di Porto Torres (SS) riceve il polisonnografo modello Titanium di proprietà terzi, dal Cliente ASL 7 Carbonia che ne richiede la riparazione causa guasto.
- L'apparecchiatura viene prontamente inviata al centro di assistenza tecnica (S.A.T.) Sapio Life di Vaprio d'Adda (MI) dove i nostri tecnici appurano che il non funzionamento del polisonnografo è causato da un danneggiamento alla componentistica hardware non riparabile in loco. Il polisonnografo viene pertanto spedito presso il centro assistenza del produttore Embla in Inghilterra.
- Sapio Life, nel frattempo, mette a disposizione dell'U.O. di Pneumologia della ASL7 di Carbonia, in comodato d'uso gratuito, un'apparecchiatura sostitutiva (c.d. muletto) consentendo quindi al reparto di svolgere in modo continuativo le prestazioni di monitoraggio cardio-respiratorio verso i propri assistiti.
- A causa di un guasto informatico, il produttore Embla perde traccia del polisonnografo Titanium che va perso.
- A fronte del danno arrecato al proprio cliente, Sapio Life, in accordo con il Dott. Greco responsabile dell'U.O. di Pneumologia di codesta spett.le ASL, dona al reparto N. 3 polisonnografi di nuova generazione modello MPR PG XS (serial number: C1000322-EBMPG, C1000401-EBMPG, C1000402-EBMPG) di valore complessivo pari al valore del Titanium smarrito.

1/2

FROM: SAPIO MONZA

TO: 07813922301

10/02/2013 09:36

#843 P.0087003



Prot 510/13
02 OTT 2013

Così facendo oltre a recuperare il valore del bene andato perso il reparto può usufruire di un numero maggiore di polisonnigrafi che gli consentono quindi di potenziare il proprio servizio di polisonnografia.

Scusandoci anche a nome di Embla che in Italia Sapiro Life rappresenta quale distributore esclusivo, l'occasione ci è gradita per porgere

Distinti saluti

SAPIO LIFE S.R.L.
Il Direttore Gare e Customer Care Sanità
Sig. Claudio Colombo

Allegati: E-mail scambiate tra la scrivente ed Embla

Si esprime parere favorevole

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 CARBONIA
U.O. PNEUMOLOGIA P. S. BARBARA RIESTAS
Prim. Dott. Pietro Greco

e/e



Spett.le
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
C.a. Ing. Cristian Cocco

e.p.c. Sig. Alessandro Portas
Ingegneria Clinica

Porto Torres, 15/10/2013

Vs Richiesta e-mail datata 09/10/2013

Oggetto: Smarrimento polisonnografo modello TITANIUM EPS-0155/01-08


Spett.le Ente,

in riferimento alla vostra richiesta, a fronte del danno recato al proprio Ente ASL 7 Carbonia, in accordo con il Dott. Greco responsabile dell'U.O. di Pneumologia di Codesta Spett.le ASL, la Sapio Life S.r.l. consegna al reparto n° 3 polisonnografi di nuova generazione modello MPR PG XS (serial Number C1000322- EBMPG, C1000401-EBMPG, C1000402-EBMPG) di valore superiore del Titanium Smarrito.

N° 1 Titanium valore commerciale € 16.000,00 + iva


N° 3 Polisonnografo Embletta MPR PG XS valore commerciale € 6.500,00 + iva cad/uno.

Cordiali saluti.



1/3


Embletta MPR

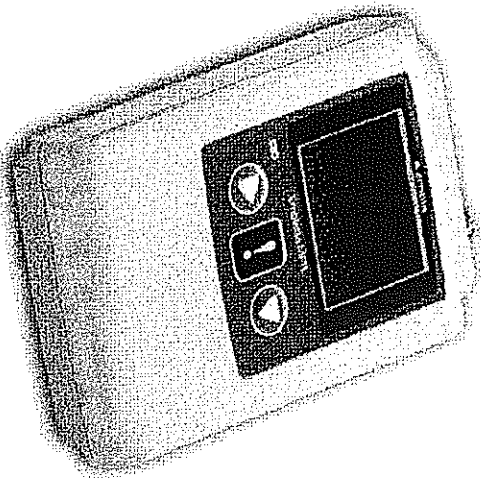


Modulo PG



Embletta MPR PG

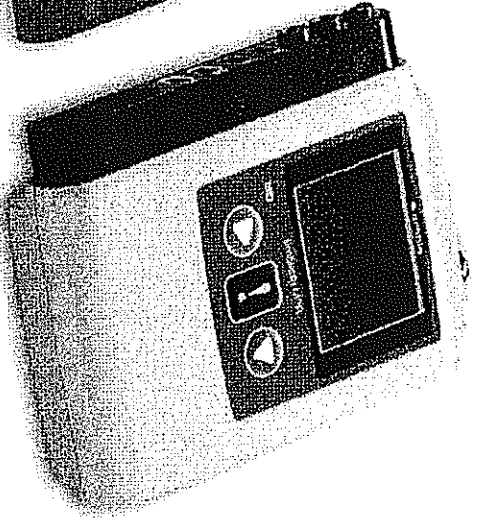

Unità remota

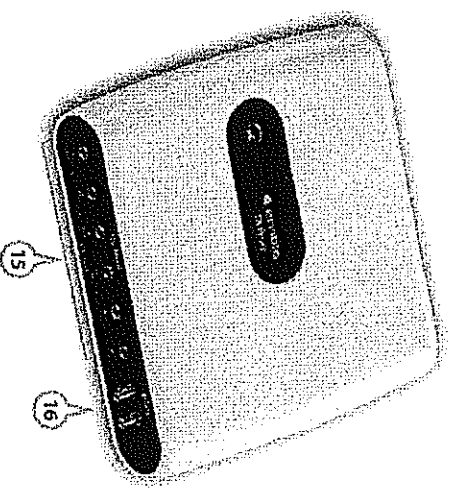

Embletta MPR



Embletta MPR è il nuovo sistema modulare di registrazione per la diagnosi dei disturbi respiratori nel sonno. Il modulo di base, Embletta MPR, consente di registrare i segnali di pressione nasale (tramite cannula nasale), puficosimetri, russamento (microfono ambientale) e posizione corporea.

Modulo PG



I canali di registrazione sono espandibili mediante il modulo Embletta MPR PG: ECG, EEG, EMG (elettrodi di superficie), flusso oro-nasale (termistore), sforzo toraco-addominale (tecnologia RIP - plestigmografia ad inducenza), canale DC per acquisizione segnali ausiliari.


Modulo TX Proxy Unit



Il modulo TX Proxy Unit comunica tramite wireless con il modulo MPR PG, consente di visualizzare in tempo reale i segnali monitorati su PC in remoto ed espande l'acquisizione con 6 canali esterni, un segnale di pressione differenziale e un sensore di luce ambientale.


USCITE EMBLETTA MPR SYSTEM

- 01. Pressione (cannula nasale)
- 02. SpO₂ e frequenza cardiaca
- 03. Russamento (microfono)

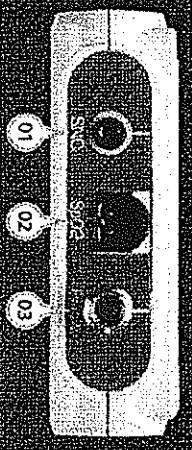


USCITE MODULO MPR-PG

- 04. ECG/PQND/REF (ECG ausiliario)
- 05. Flusso (termistore)
- 06. Fascia toracica
- 07. Fascia addominale
- 08. DC Input (ausiliario)

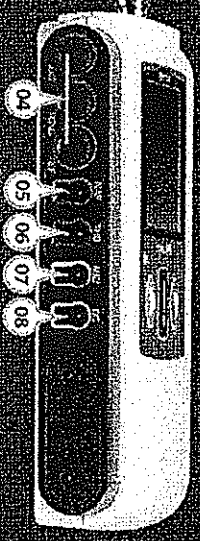

USCITE TX PROXY UNIT

- 09. Connettore alimentazione
- 10. LED accensione
- 11. Wireless
- 12. USB
- 13. LAN
- 14. GPR/Diagnostici ResMed
- 15. DC Input Ingressi Ausiliari (4-5V)
- 16. PDI/ Pressione differenziale

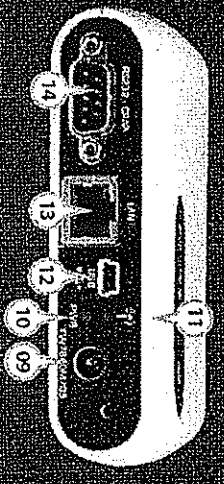

Embletta MPPR System:

È MODULARE E AGGIORNABILE

OFFRE UN ELEVATO GRADO DI FLESSIBILITÀ, DI QUALITÀ DEL SEGNALE ED EFFICIENZA NELLA RACCOLTA DEI DATI

RISPONDE IN MODO EFFICACE E COMPLETO ALLE ESIGENZE CLINICHE E DI RICERCA DAL SEMPLICE SCREENING, AL MONITORAGGIO CARDIORESPIRATORIO FINO ALLA POLISONNOGRAFIA

UTILIZZATO IN OSPEDALI, ISTITUTI, CENTRI E CLINICHE DEL SONNO E PRESSO IL DOMICILIO DEL PAZIENTE

DETTAGLI EMBLETTA MPPR SYSTEM

- Canali e segnali derivati: 21 (MPPR) + 26 (MPPR PG) + 8 (TX Proxy Unit)
- Memoria: 2 GB
- Software di analisi e referazione: RemLogic
- Monitoraggio online tramite LAN o WiFi
- Alimentazione batteria sostituibile o ricaricabile

Embletta MPPR System

SISTEMA MODULARE PER LA DIAGNOSI DEI DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO

